

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛА, АЛЬФА-, БЕТА- И ГАММА-ГХЦГ,
ДИКОФОЛА, ДИГИДРОГЕПТАХЛОРА, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-
ДДД, ТРИФЛУРАЛИНА В ВОДАХ
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ**

Ростов-на-Дону
1995

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Гидрохимическим институтом

2 РАЗРАБОТЧИКИ Ю.Я. Винников, канд. хим. наук
(руководитель разработки); Г.И. Ганин, канд. хим. наук; Е.В. Федорова

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Начальником ГУЭМЗ
Росгидромета Цатуровым Ю.С. 17.04.95 г.

4 ОДОБРЕН Секцией по методам химического и радиологического
мониторинга природной среды ЦКПМ Росгидромета 11.04.95 г.,
протокол N 2.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ МВИ Выдано
Гидрохимическим институтом в 1995 г. N 66

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН в 1995 г. N 412

7 ВЗАМЕН РД 52.24.66-88

Введение

Галогенорганические инсектициды и гербициды широко применяются в агрохимической практике для борьбы с насекомыми-вредителями и сорной растительностью, что обуславливает поступление этих пестицидов в водные объекты с ливневым стоком с сельхозугодий и через атмосферу.

Из-за значительных объемов применения и свойств ряд галогенорганических пестицидов - альфа-ГХЦГ (альфа-изомер гексахлорциклогексана), гамма-ГХЦГ (гамма-изомер гексахлорциклогексана, линдан, гамматокс), 4,4'-ДДТ (п,п'-ДДТ, дикофан, аэротокс), 4,4'-ДДЕ (п,п'-ДДЕ), 4,4'-ДДД (п,п'-ДДД, ротан, ТДЕ), дикофол (акарин, кельтан, хлорэтанол), трифлуралин (олитреф, трефлан) - включен в приоритетный перечень пестицидов, подлежащих контролю в поверхностных водах суши.

Методика предназначена для определения приоритетных галогенорганических пестицидов - хлорорганических (альфа- и гамма-ГХЦГ, дикофола, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД) и трифлуралина в поверхностных водах суши и очищенных сточных водах. В случае необходимости методика предусматривает, кроме того, количественное определение гексахлорбензола (ГХБ, гексадина) и дигидрогептахлора (бета-дигидрогептахлора, дилора), не включённых в приоритетный перечень, но распространённых и встречающихся в поверхностных водах пестицидов, а также приоритетного для почв бета-изомера ГХЦГ.

Предельно допустимые в поверхностных водах суши концентрации определяемых по настоящей методике пестицидов приведены в таблице 1.

Газохроматографическому определению пестицидов мешают некоторые соединения, не разрушающиеся при обработке экстракта концентрированной серной кислотой и имеющие времена удерживания, близкие к таковым для определяемых пестицидов. К таким соединениям относятся полихлорбифенилы (ПХБ), хлорированные парафины, галоваксы (полихлорнафталины), токсафены, тиодан, эфиры фталевой кислоты и некоторые другие. С целью более точной идентификации

Таблица 1 - Предельно допустимые концентрации галогенорганических пестицидов в поверхностных водах суши

Пестицид	ПДК, мкг/дм ³	
	хозяйственно-питьевых	рыбохозяйственных
Гексахлорбензол	1	не установлена
Альфа-ГХЦГ	20	отсутствие
Бета-ГХЦГ	20	отсутствие
Гамма-ГХЦГ	4	отсутствие
Дигидрогептахлор	40	0,5
Трифлуралин	20	0,3
4,4'-ДДЕ	2	отсутствие
4,4'-ДДД	2	отсутствие
4,4'-ДДТ	2	отсутствие
Дикофол	20	отсутствие

пестицидов в случае присутствия в экстрактах таких соединений проводят обработку экстракта спиртовой щёлочью (щелочное дегидрохлорирование).

Мешающее влияние сероорганических веществ, сероводорода и элементарной серы, если это необходимо, устраняют обработкой экстрактов активированной медью или раствором сульфата тетрабутиламмония в присутствии изопропилового спирта и сульфита натрия.

При использовании по варианту 2 (однократное экстрагирование проб воды н-гексаном объёмом 2,5 см³) настоящий РД может применяться совместно с вариантом 2 РД 52.24.485-95 "Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации хлорпирифоса в поверхностных водах суши газохроматографическим методом" в целях определения в одной пробе воды хлорпирифоса, хлорорганических пестицидов и трифлуралина.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛА, АЛЬФА-, БЕТА- И ГАММА-ГХЦГ, ДИКОФОЛА, ДИГИДРОГЕПТАХЛОРА, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, ТРИФЛУРАЛИНА В ВОДАХ ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Дата введения 01.07.95 г.

1 Назначение и область применения методики

Настоящий руководящий документ устанавливает газохроматографическую методику выполнения измерений массовой концентрации ГХБ, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД и трифлуралина в пробах поверхностных вод суши и очищенных сточных вод в диапазоне 0,002-0,050 мкг/дм³ для ГХБ, альфа-ГХЦГ и гамма-ГХЦГ, 0,005-0,150 мкг/дм³ для трифлуралина, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДЕ, 0,010-0,300 мкг/дм³ для бета-ГХЦГ и 4,4'-ДДД, 0,020-0,500 мкг/дм³ для 4,4'-ДДТ и дикофола. При анализе проб воды с массовой концентрацией определяемых пестицидов, превышающей верхний предел указанных выше соответствующих диапазонов, необходимо разбавление экстракта, подлежащего хроматографированию.

2 Нормы погрешности и значения характеристик погрешности измерения

В соответствии с ГОСТ 27384 нормы погрешности при выполнении измерений галогенорганических пестицидов в природных водах составляют для ГХБ ± 50 %; для гамма-ГХЦГ в диапазоне массовых концентраций от 0,08 до 1 мкг/дм³ минус 65 - плюс 100 %, от 1,0 до

10 мкг/дм³ ± 50 %, свыше 10 мкг/дм³ ± 25 %; для 4,4'-ДДТ и дикофола в диапазоне массовых концентраций от 0,2 до 1 мкг/дм³ включительно минус 65 - плюс 100 %.

Для массовых концентраций гамма-ГХЦГ менее 0,08 мкг/дм³ и для массовых концентраций дикофола и 4,4'-ДДТ менее 0,2 мкг/дм³, а также для альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, трифлуралина, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД и дигидрогептахлора нормы погрешности не установлены.

Установленные для настоящей методики значения характеристик погрешностей и их составляющих приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Значения характеристик погрешности и её составляющих при определении галогенорганических пестицидов по варианту 1 методики (P=0,95)

Пестицид	Диапазон измеряемых концентраций С, мкг/дм ³	Характеристики составляющих погрешности, мкг/дм ³		Характеристика погрешности, мкг/дм ³ , Δ
		случайной, $\sigma(\Delta)$	систематической Δ_c	
ГХБ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,056 C$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,045 C$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,11 C$
Альфа-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,087 C$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,069 C$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,17 C$
Бета-ГХЦГ	0,010 - 0,300	$0,001 + 0,056 C$	$0,001 + 0,045 C$	$0,003 + 0,11 C$
Гамма-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,090 C$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,072 C$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,18 C$
Дигидрогептахлор	0,0050 - 0,150	$3 \cdot 10^{-4} + 0,061 C$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,049 C$	$7 \cdot 10^{-4} + 0,12 C$
4,4'-ДДЕ	0,0050 - 0,150	$0,001 + 0,047 C$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,037 C$	$0,002 + 0,093 C$
4,4'-ДДД	0,010 - 0,300	$6 \cdot 10^{-4} + 0,11 C$	$5 \cdot 10^{-4} + 0,085 C$	$0,001 + 0,22 C$
4,4'-ДДТ	0,020 - 0,500	$0,005 + 0,048 C$	$0,004 + 0,038 C$	$0,010 + 0,096 C$
Дикофол	0,020 - 0,500	$0,003 + 0,045 C$	$0,002 + 0,036 C$	$0,005 + 0,090 C$
Трифлуралин	0,0050 - 0,150	$8 \cdot 10^{-4} + 0,074 C$	$6 \cdot 10^{-4} + 0,059 C$	$0,0016 + 0,15 C$

Таблица 3 - Значения характеристик погрешности и её составляющих при определении галогенорганических пестицидов по варианту 2 методики (P=0,95)

Пестицид	Диапазон измеряемых концентраций С, мкг/дм ³	Характеристики составляющих погрешности, мкг/дм ³		Характеристика погрешности, мкг/дм ³ , Δ
		случайной, $\sigma(\Delta)$	систематической Δ _с	
ГХБ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,044 С$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,035 С$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,089 С$
Альфа-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$6 \cdot 10^{-4} + 0,10 С$	$4 \cdot 10^{-4} + 0,081 С$	$0,0011 + 0,20 С$
Бета-ГХЦГ	0,010 - 0,300	$0,002 + 0,049 С$	$0,001 + 0,040 С$	$0,003 + 0,089 С$
Гамма-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$5 \cdot 10^{-4} + 0,079 С$	$4 \cdot 10^{-4} + 0,063 С$	$0,0010 + 0,16 С$
Дигидро-гептахлор	0,0050 – 0,150	$0,0012 + 0,020 С$	$0,0010^4 + 0,016 С$	$0,0024 + 0,041 С$
4,4'-ДДЕ	0,0050 – 0,150	$0,001 + 0,036 С$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,029 С$	$0,0019 + 0,072 С$
4,4'-ДДД	0,010 – 0,300	$0,003 + 0,019 С$	$0,002 + 0,015 С$	$0,005 + 0,039 С$
4,4'-ДДТ	0,020 – 0,200 св. 0,200-0,500	$0,001 + 0,092 С$ 0,019	$0,001 + 0,073 С$ 0,015	$0,003 + 0,18 С$ 0,038
Дикофол	0,020 – 0,500	$0,001 + 0,060 С$	$0,001 + 0,048 С$	$0,003 + 0,12 С$
Трифлурал ин	0,0050 – 0,0500 св. 0,0500 - 0,150	0,15 С 0,0074	0,12 С 0,0059	$1 \cdot 10^{-4} + 0,29 С$ 0,015

При выполнении измерений массовой концентрации пестицидов свыше 0,050 мкг/дм³ для ГХБ, альфа- и гамма-ГХЦГ, свыше 0,150 мкг/дм³ для трифлуралина, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДЕ, свыше 0,300 мкг/дм³ для бета-ГХЦГ и 4,4'-ДДД, свыше 0,500 мкг/дм³ для 4,4'-ДДТ и дикофола погрешности измерения для соответствующих пестицидов не превышают значений, рассчитанных по приведенным в таблицах 2 и 3 зависимостям.

3 Метод измерения

Определение основано на извлечении пестицидов из воды экстрагированием н-гексаном, очистке экстракта концентрированной

серной кислотой и количественном их определении методом газожидкостной хроматографии с детектором по захвату электронов.

Методика представлена в двух вариантах. По варианту 1 извлечение пестицидов из пробы воды осуществляют с помощью двукратной экстракции н-гексаном ($2 \cdot 20 \text{ см}^3$); по варианту 2 - с помощью микроэкстракции, т.е. однократной экстракции н-гексаном объёмом 2,0-2,5 см^3 .

Вариант 2 более экспрессен и менее трудоёмок, но требует более высокой квалификации аналитика.

Идентификацию определяемых пестицидов проводят по временам удерживания. Последние для некоторых из пестицидов могут быть слишком близкими или вовсе совпадать при разделении на одной фазе. Поэтому для каждой серии однотипных проб следует устанавливать однозначность идентификации разделением на колонках с фазами различной полярности, например, SE-30 и XE-60 или OV-17 и XE-60.

Количественный расчёт содержания определяемых пестицидов проводят по высотам их хроматографических пиков на хроматограммах стандартного раствора и экстракта пробы воды.

4 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы, материалы

4.1 Средства измерений, вспомогательные устройства

4.1.1 Хроматограф газовый типа Цвет-550 или другого типа с детектором по захвату электронов (ДПР, ИРД и др. типа) - 1

4.1.2 Весы аналитические 2 класса точности по ГОСТ 24104 или другого типа, равноценные по точности - 1

4.1.3 Весы технические лабораторные 4 класса точности с пределом взвешивания 200 г - 1


4.1.4 Микрошприц МШ-10М, ТУ 2-833-106 - 1

4.1.5 Дозатор пипеточный П1 с объёмом дозы 0,5 см^3 , ТУ 64-1-3329 - 1

4.1.6 Муфельная печь с регулируемым нагревом любого типа - 1

4.1.7 Шкаф сушильный любого типа - 1

4.1.8 Микрокомпрессор аквариумный любого типа	- 1
4.1.9 Насос вакуумный ВН-494 или аналогичного типа	- 1
4.1.10 Центрифуга настольная ОПн-3 с ротором-крестовиной или аналогичного типа со скоростью вращения до 3000 об/мин	- 1
4.1.11 Мешалка магнитная ММ-3 или аналогичного типа	- 1
4.1.12 Плитка электрическая с закрытой спиралью с регулируемым нагревом	- 1
4.1.13 Баня водяная любого типа	- 1
4.1.14 Испаритель ротационный ИР-1М, ТУ 25-11-917	- 1
или аппарат для концентрирования экстрактов (аппарат Кудерна-Даниша, см. рисунок 1а),	- 6
или колбы с Г-образным отводом вместимостью 100 см ³ , (см. рисунок 1б)	- 6
4.1.15 Колонки хроматографические стеклянные длиной 2 м с внутренним диаметром 3 мм	- 2
4.1.16 Колбы мерные, ГОСТ 1770, вместимостью:	50 см ³ - 35
	100 см ³ - 10
4.1.17 Пипетки градуированные не ниже 2 класса точности, ГОСТ 29227, вместимостью:	1 см ³ - 5
	2 см ³ - 5
	5 см ³ - 5
4.1.18 Цилиндры мерные, ГОСТ 1770, вместимостью:	10 см ³ - 5
	25 см ³ - 2
	100 см ³ - 1
	1000 см ³ - 1
4.1.19 Пробирки градуированные с притёртыми пробками исполнения 2, ГОСТ 1770, вместимостью	10 см ³ - 8
4.1.20 Колбы конические с притёртыми пробками, ГОСТ 25336, вместимостью:	25 см ³ - 6
	50 см ³ или 100 см ³ - 6
4.1.21 Воронки делительные, ГОСТ 25336, вместимостью	25 см ³ - 1
	100 см ³ - 6
	250 см ³ - 6
	500 см ³ - 1
	1000 см ³ - 6

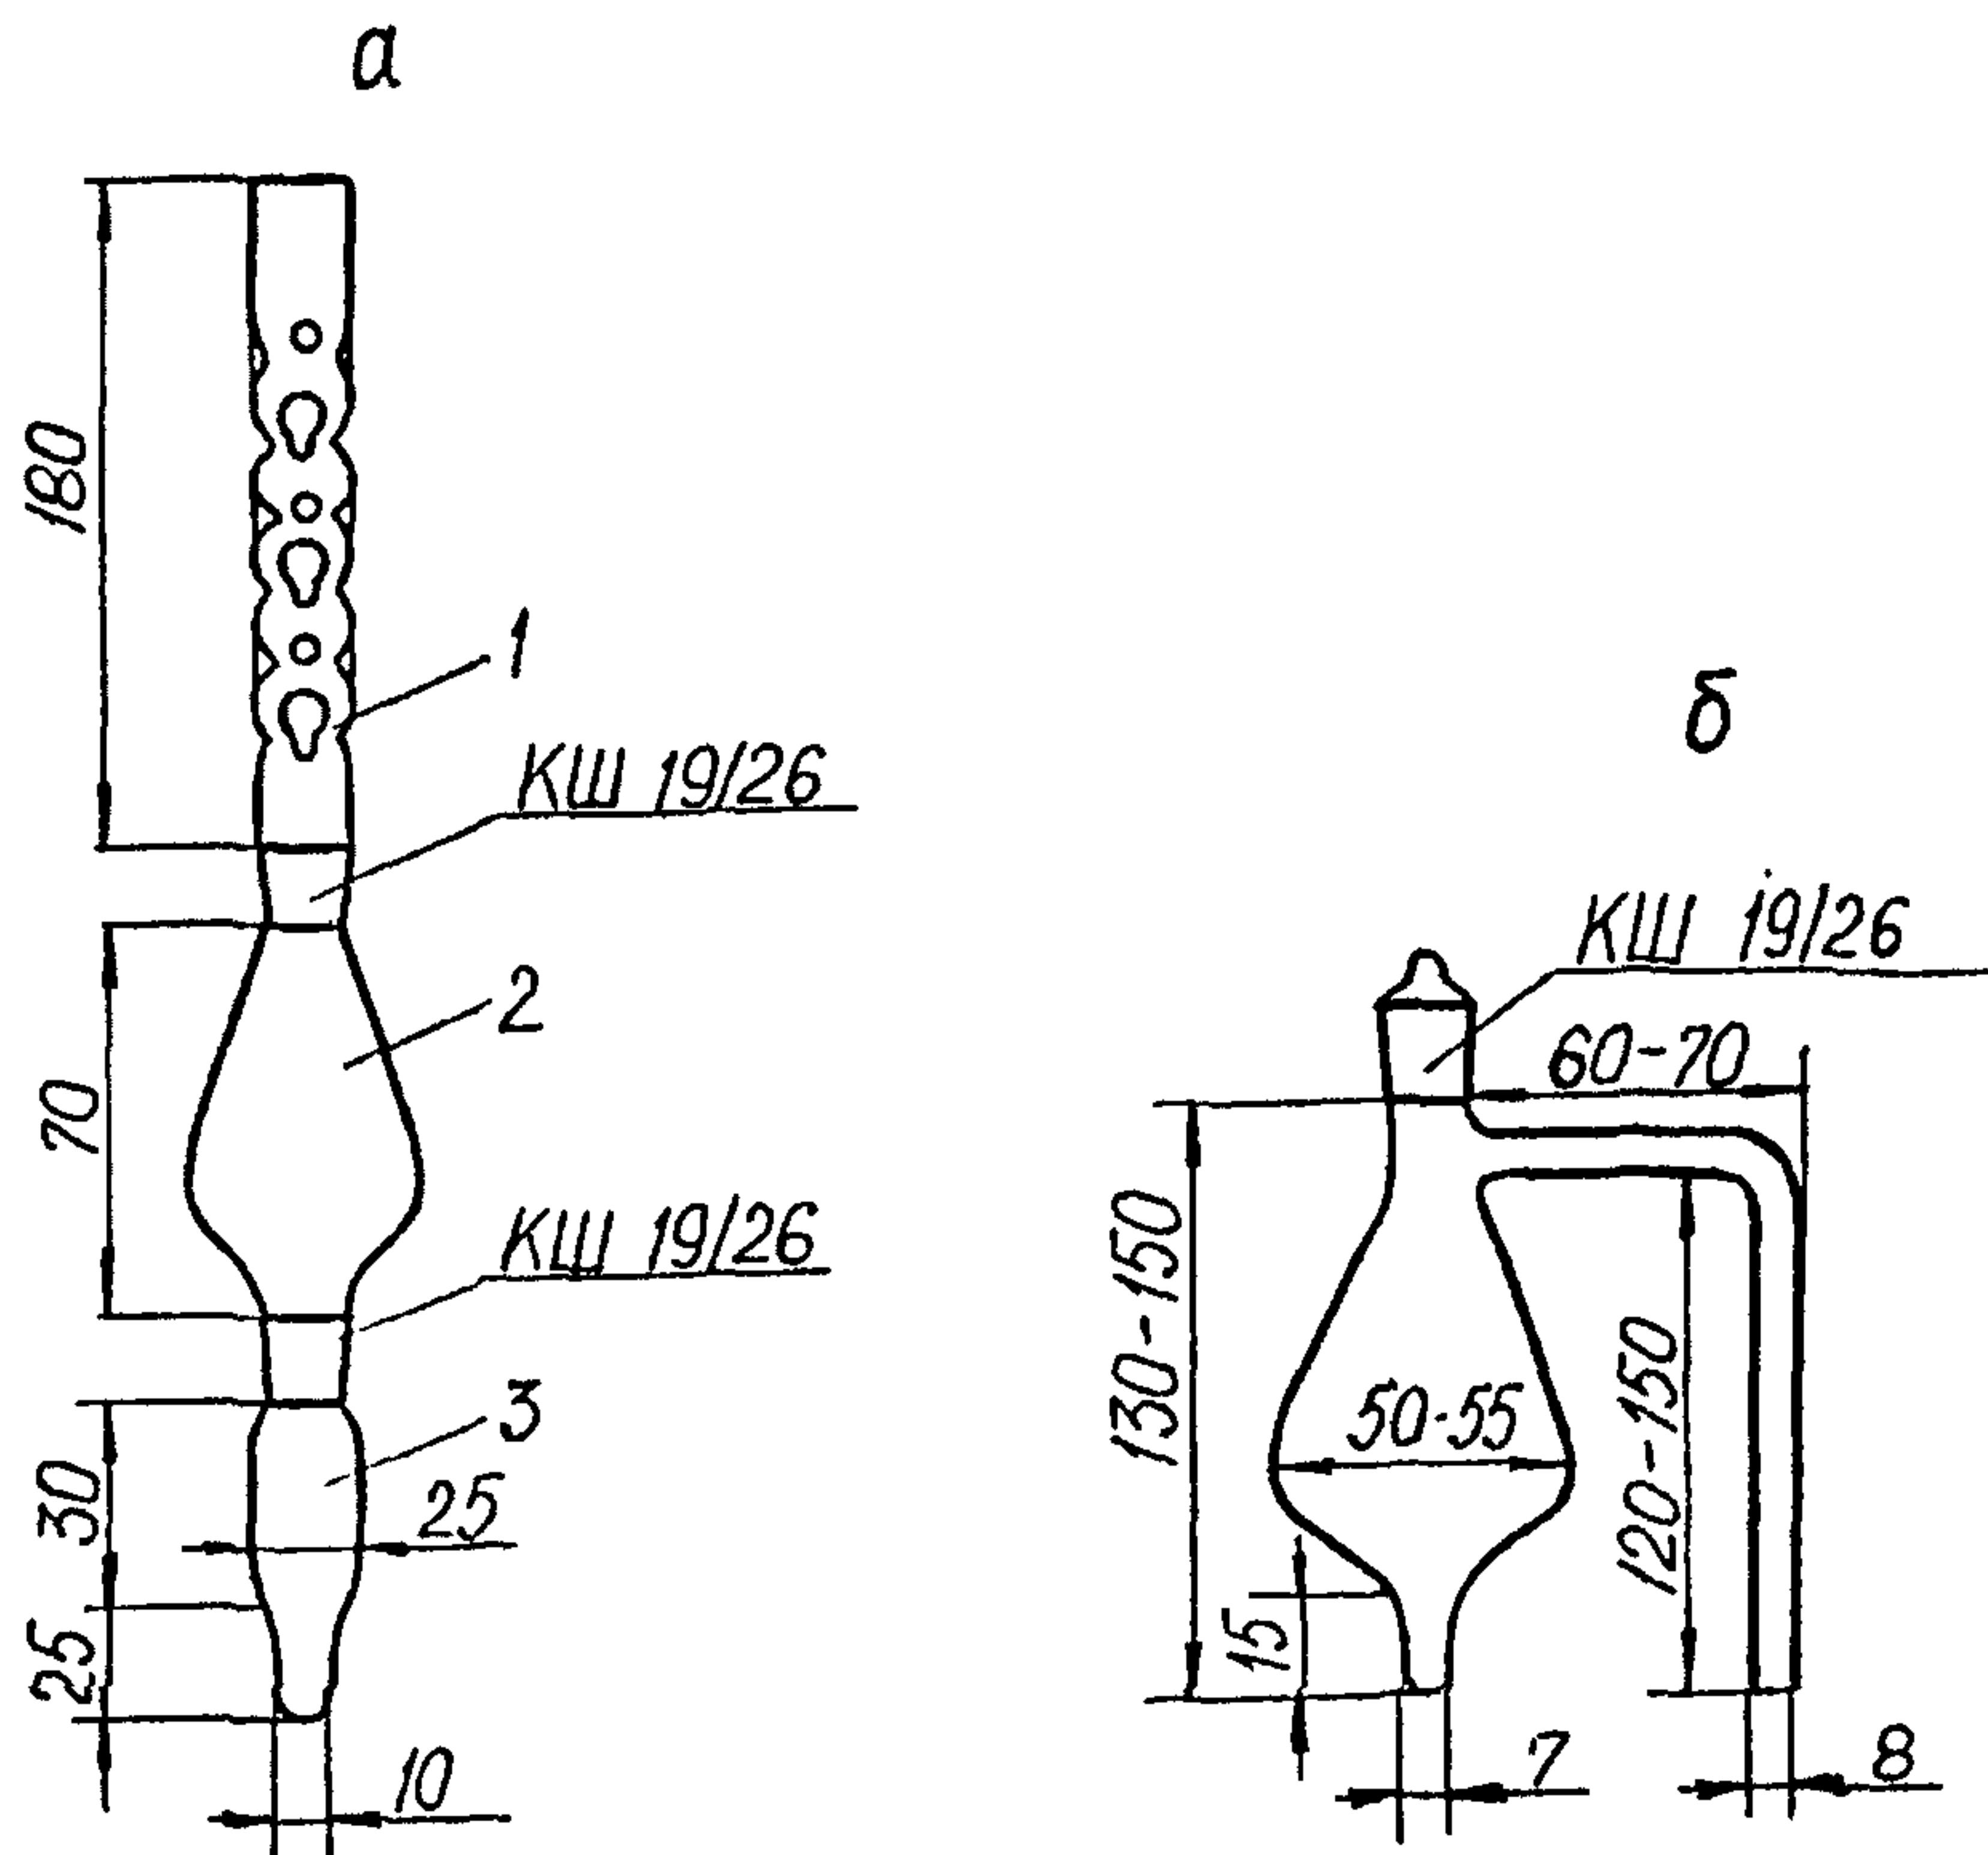

а - аппарат Кудерна-Даниша (1 - дефлегматор, 2 - средняя часть аппарата, 3 - пробирка для сбора концентрата);
б - колба с Г-образным отводом

Рисунок 1 - Устройства для концентрирования экстрактов

- 4.1.22 Воронки лабораторные, ГОСТ 25336, диаметром 40-60 мм - 6
- 4.1.23 Химические стаканы, ГОСТ 25336, вместимостью: 50 см³ - 6
1000 см³ - 6
- 4.1.24 Пробки стеклянные с конусным шлифом с соединительным краном, ОСТ 25-79 - 6
- 4.1.25 Холодильник с прямой трубкой со шлифом ХПТ-ХШ, ГОСТ 25336 - 6
- 4.1.26 Стеклянный бюкс или стаканчик для взвешивания с притёртой крышкой вместимостью 50 см³, ГОСТ 25336 - 1
- 4.1.27 Воронки делительные, вместимостью 10 см³ по ГОСТ 25336 или см. рисунок 2а - 6
- 4.1.28 Пробирки градуированные с притёртыми пробками вместимостью 5 см³ по ГОСТ 1770 или см. рисунок 2б - 12
- 4.1.29 Пипетка для отбора гексановых микроэкстрактов (рисунок 2в) - 1
- 4.1.30 Сменные капилляры к пипеткам для отбора микроэкстрактов к дозатору пипеточному (рисунок 2в) - 18
- 4.1.31 Эксикатор, ГОСТ 25336 - 1
- 4.1.32 Склянка для очистки газов, СПТ, ГОСТ 25336 - 1

4.2 Реактивы и материалы

4.2.1 Стандартные образцы или препараты альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, дигидрогептахлора, дикофола, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, 4,4'-ДДТ, гексахлорбензола, трифлуралина с содержанием основного вещества не менее 95 %


4.2.2 Хроматон N-AW-DMCS (N-AW-HMDS, N-Super) или Инертон AW-DMCS (фракция О,16-О,20 мм) с 5 % нанесённой неподвижной фазы SE-30 или с 3 % OV-17

4.2.3 Хроматон N-AW-DMCS (N-AW-HMDS, N-Super) или Инертон AW-DMCS (фракция О,16-О,20 мм) с 5 % нанесённой неподвижной фазы ХЕ-60

4.2.4 н-Гексан, ч., ТУ 6-09-3375, перегнанный

4.2.5 Ацетон, ч.д.а., ГОСТ 2603, свежеперегнанный или ацетон, ос.ч., ТУ 6-09-3513

4.2.6 Спирт этиловый ректифицированный, ГОСТ 18300

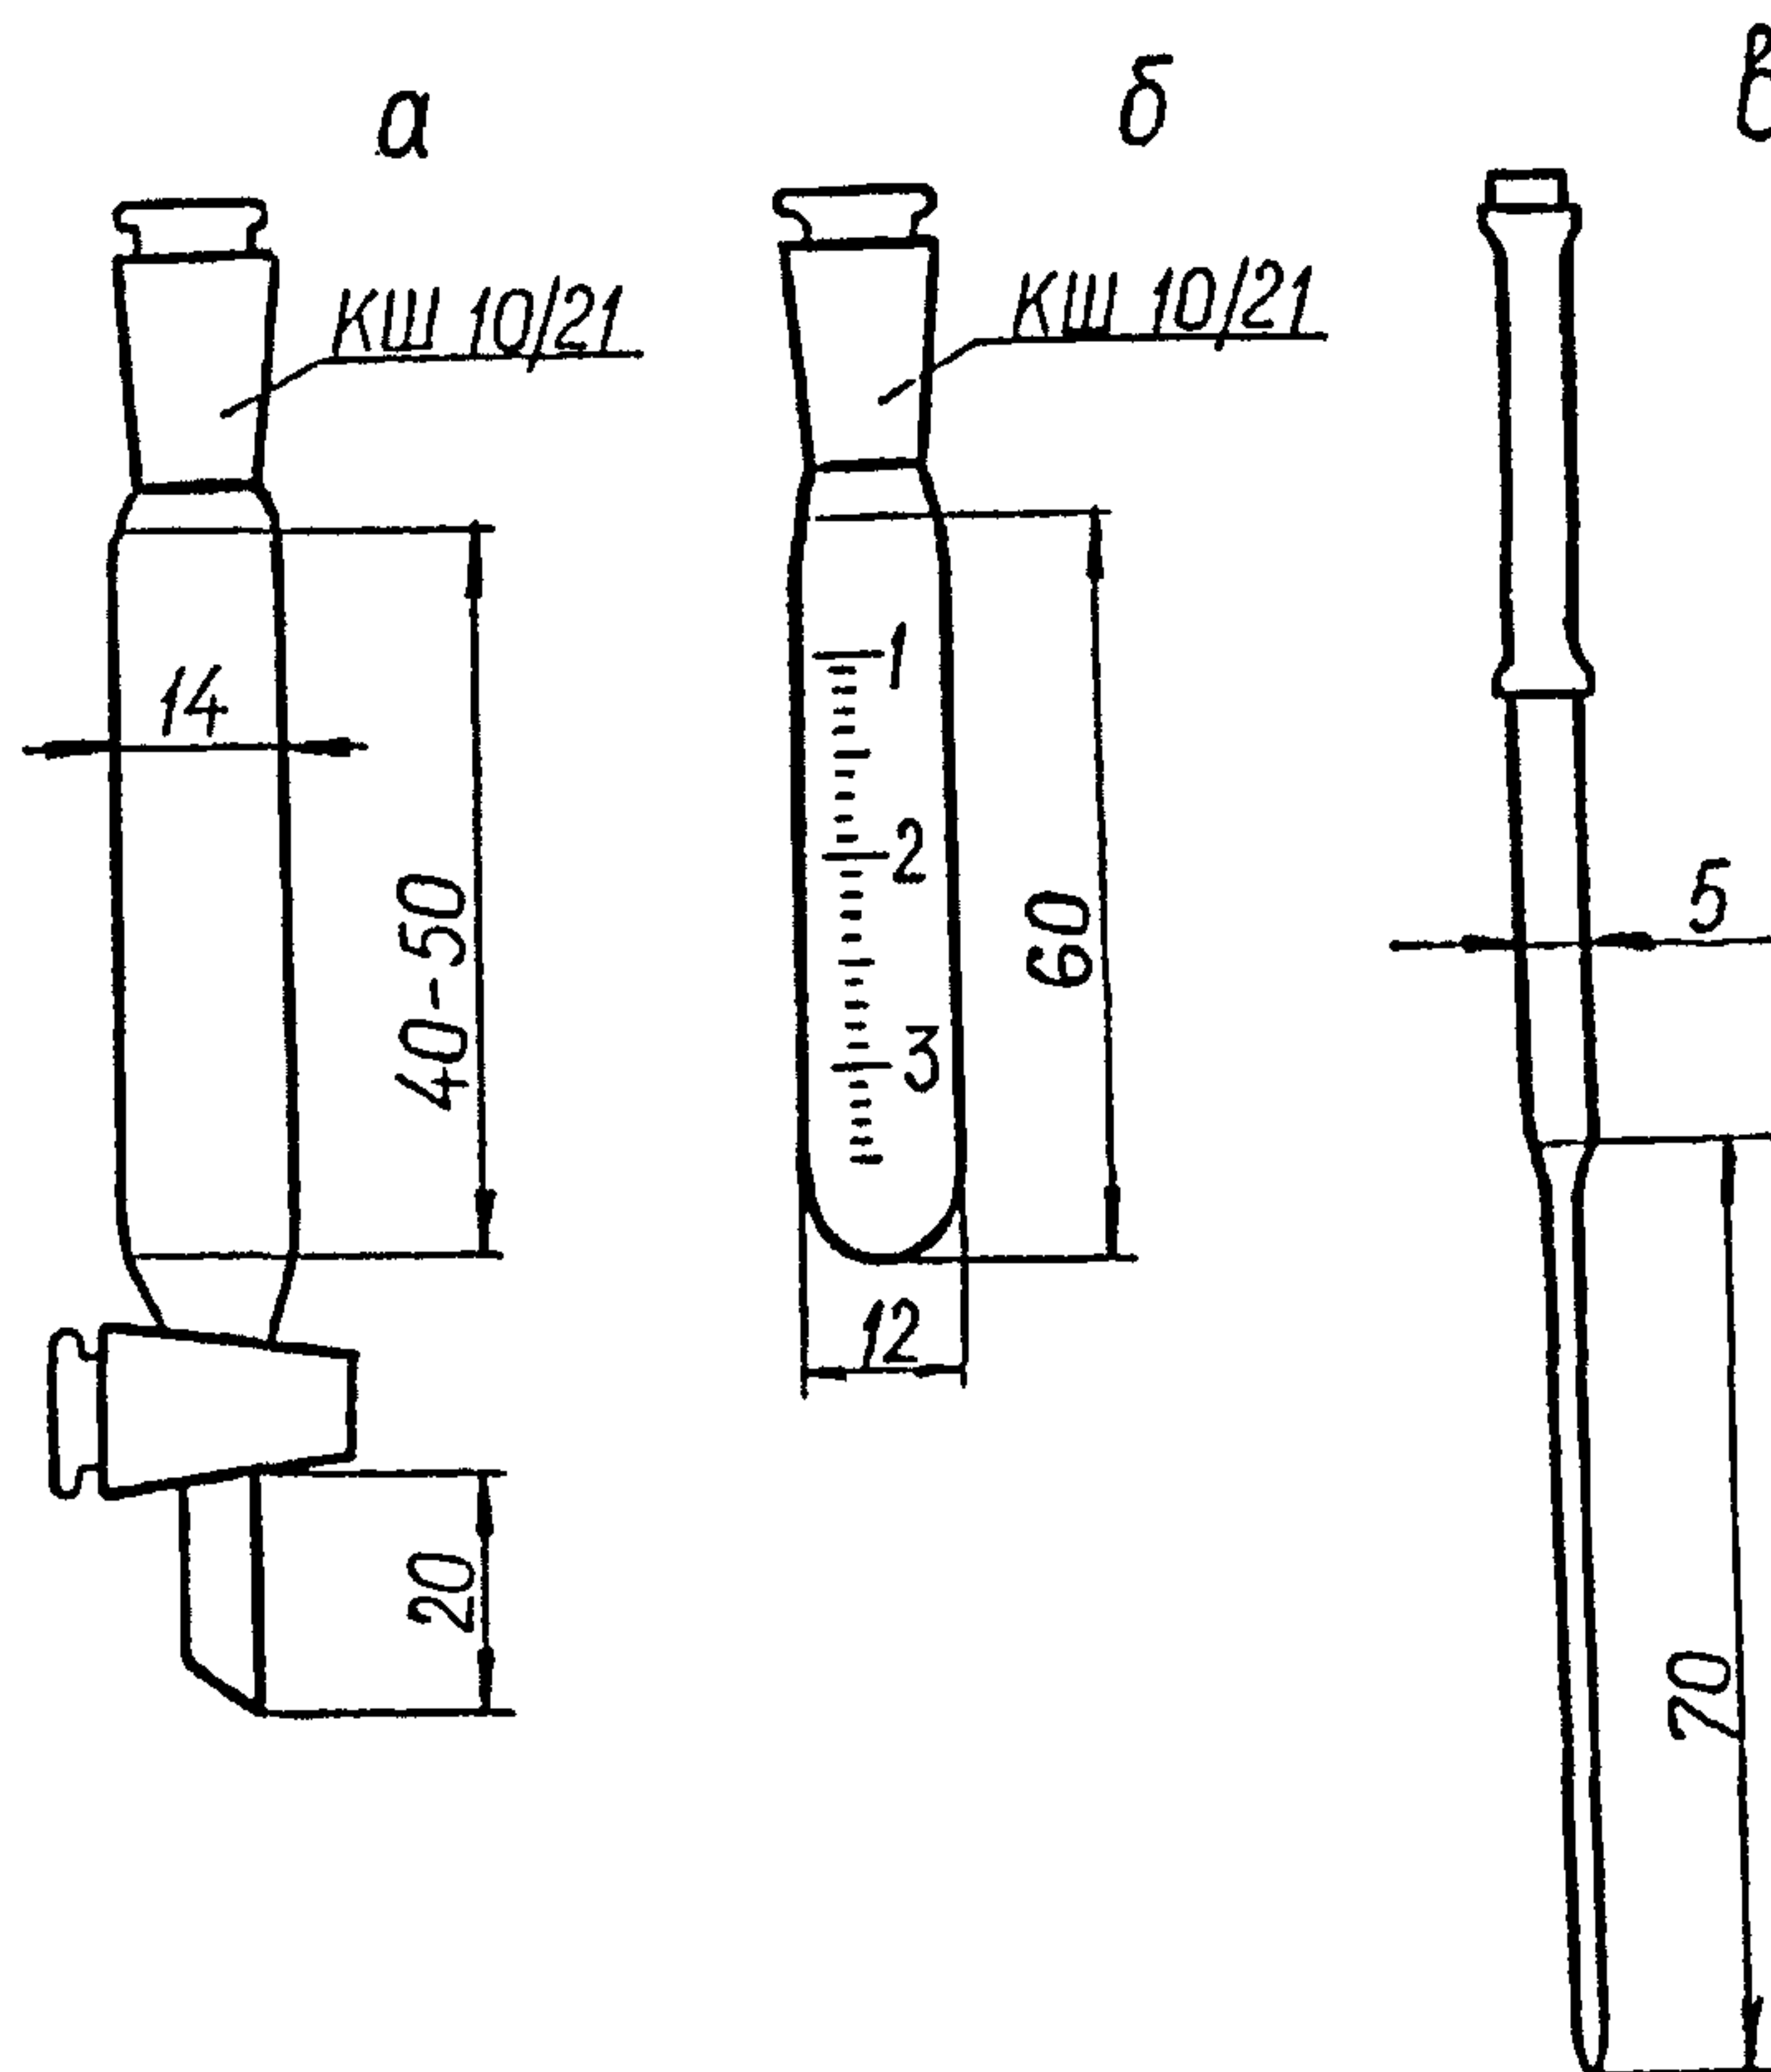

- а - делительная воронка вместимостью 10 см;
б - пробирка с притёртой пробкой для сбора микроэкстрактов;
в - пипетка со сменными капиллярами для сбора микроэкстрактов

Рисунок 2 - Нестандартное оборудование для работы с микроэкстрактами

- 4.2.7 Кислота серная, х.ч., концентрированная, ГОСТ 4204
- 4.2.8 Кислота азотная, х.ч., ГОСТ 4461
- 4.2.9 Спирт изопропиловый, х.ч., ТУ 6-09-402
- 4.2.7 Сульфат натрия безводный, ч.д.а., ГОСТ 4166
- 4.2.8 Гидроксид натрия, ч.д.а., ГОСТ 4328
- 4.2.9 Бумага индикаторная универсальная, ТУ 6-09-1181
- 4.2.10 Сульфит натрия безводный, ч.д.а., ГОСТ 195
- 4.2.11 Гидрокарбонат натрия, х.ч., ГОСТ 4201
- 4.2.12 Гидроксид калия, х.ч., ГОСТ 4328
- 4.2.13 Тетрабутиламмония сульфат, ч., 15 % водный раствор, ТУ 6-09-05-719
- 4.2.14 Медь металлическая электролитическая ГОСТ 859 или оксид меди, ч. или ч.д.а.
- 4.2.15 Азот газообразный особой чистоты, МРТУ 6-02-375, или азот нулевой поверочный, ТУ 6-21-39 - 1 баллон
- 4.2.16 Уголь активный БАУ, ГОСТ 6217
- 4.2.17 Стеклоткань или стекловата, ГОСТ 10146, промытая ацетоном и н-гексаном
- 4.2.18 Вата медицинская, ГОСТ 5556, промытая н-гексаном
- 4.2.19 Вода дистиллированная, ГОСТ 6709
- 4.2.20 Трубка Ф-4Д электроизоляционная фторопластовая с внутренним диаметром 4-5 мм
- 4.2.21 Трубка из силиконовой резины с внутренним диаметром 5-6 мм

5 Отбор и хранение проб

Отбор проб воды осуществляют в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05 с помощью стеклянного батометра. Из батометра пробу без фильтрации переносят в стеклянные бутылки вместимостью 1 дм³ и закрывают притёртыми стеклянными или обёрнутыми тефлоновой пленкой или алюминиевой фольгой корковыми пробками. Применение полиэтиленовой посуды, резиновых и полиэтиленовых пробок не допускается.

Пробы воды хранят не более 10 сут при температуре 5-7 °С.

Гексановые экстракты хранят только в стеклянной посуде с притёртыми пробками в темноте при температуре 5-7 °С. Срок хранения неочищенных экстрактов - не более 10 сут, очищенных - до 3 мес.

6 Подготовка к выполнению измерений

6.1 Приготовление растворов и реактивов

6.1.1 Дистиллированная вода, очищенная н-гексаном

Очищают, экстрагируя 1 дм³ дистиллированной воды в делительной воронке 10 см³ н-гексана и отбрасывая гексановый экстракт.

6.1.2 Сульфат натрия безводный

Перед использованием сульфат натрия прокаливают в муфельной печи при температуре 350-400 °С в течение 8 ч. Прокаленный сульфат натрия хранят в эксикаторе.

6.1.3 Сульфат натрия, водный раствор

Растворяют 130 г безводного сульфата натрия в дистиллированной воде и доводят объём раствора до 1 дм³. Приготовленный раствор очищают, экстрагируя его 20 см³ н-гексана.

6.1.4 Гидрокарбонат натрия, 0,5 % водный раствор

В 200 см³ дистиллированной воды растворяют 1 г гидрокарбоната натрия. Приготовленный раствор очищают, экстрагируя его 10 см³ н-гексана.

6.1.5 Тетрабутиламмоний сульфат (ТБА), водный раствор

Раствор ТБА готовят непосредственно перед употреблением. Для этого к 11 см³ 15 %-ного водного раствора ТБА (4.2.13) приливают 38 см³ дистиллированной воды и добавляют 12,5 г сернистокислого натрия. Приготовленный раствор ТБА очищают трёхкратной экстракцией н-гексаном объёмами по 10 см³.

6.1.6 Кислота серная, 1 % водный раствор

Раствор готовят, приливая 1,1 см³ концентрированной серной кислоты в 200 см³ дистиллированной воды, очищенной н-гексаном.

6.1.7 Кислота азотная, водный раствор 6 моль/дм³

Раствор готовят, приливая 50 см³ концентрированной азотной кислоты при помешивании к 150 см³ дистиллированной воды.

6.1.8 Медь металлическая, опилки или крупка

Опилки получают, обрабатывая слиток меди напильником или ножовкой по металлу. Изменяя силу нажима на напильник или ножовку, добиваются того, чтобы размер крупинок меди составлял 0,2-0,5 мм. Предназначенные для получения медных опилок напильник или полотно ножовки должны быть обезжирены промывкой последовательно ацетоном и н-гексаном.

Медная крупка нужного размера может быть получена восстановлением в токе водорода при температуре 300 °С отсоединенного оксида меди.

Полученные медные опилки или медную крупку помещают в бюкс и активируют их обработкой раствором азотной кислоты (6.1.7) в течение 20-30 с. После этого опилки или крупку промывают дистиллированной водой 4-5 раз и затем 5-6 раз ацетоном. После ацетона медные опилки или крупку промывают 3-4 раза н-гексаном. Хранят активированные медные опилки или крупку в бюксе под слоем н-гексана 2 суток, после чего необходимо провести повторное активирование. Наиболее целесообразно активировать такое количество меди, которое необходимо на 1 день работы.

6.2 Приготовление стандартных растворов гексахлорбензола, альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, дигидрогептахлора, дикофола, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, 4,4'-ДДТ, трифлуралина

Стандартные растворы пестицидов готовят из стандартных образцов или препаратов пестицидов.

В случае использования стандартных образцов пестицидов производят разбавление исходных растворов в соответствии с инструкцией по их применению.

Стандартные растворы пестицидов готовят, используя в качестве растворителей н-гексан и ацетон. Растворы в н-гексане используют для приготовления стандартных образцов сравнения при хроматографировании (7.5), растворы в ацетоне - в качестве добавок в

пробы природной воды при определении коэффициентов пересчёта (7.6) и при внутрилабораторном контроле.

6.2.1 Основные стандартные растворы

Перед проведением операций по приготовлению растворов пестицидов весовым методом необходимо препараты пестицидов и н-гексан выдержать в течение двух часов в рабочем помещении.

На аналитических весах отвешивают 0,005 или 0,010 г пестицида, количественно переносят навеску в мерную колбу вместимостью 50 или 100 см³ соответственно взятой навеске, растворяют в небольшом количестве н-гексана и доводят объём до метки н-гексаном спустя 2-3 ч после растворения пестицида. Полученному раствору приписывают концентрацию 100 мкг/см³.

Процедура приготовления основного стандартного раствора одинакова для всех пестицидов. В качестве основных стандартных растворов могут быть применены стандартные образцы пестицидов (ГСО) концентрацией 100 мкг/см³.

Растворы хранят в холодильнике не более 6 мес.

6.2.2 Промежуточные стандартные растворы 1

В мерную колбу вместимостью 50 см³ пипеткой отбирают 5 см³ основного стандартного раствора или стандартного образца пестицида и доводят объём до метки на колбе н-гексаном. Полученному раствору приписывают концентрацию 10 мкг/см³.

Процедура приготовления промежуточного стандартного раствора 1 одинакова для всех пестицидов.

Растворы хранят в холодильнике не более 3 мес.

6.2.3 Промежуточные стандартные растворы 2

В мерную колбу вместимостью 50 см³ пипеткой отбирают 1,25 см³ промежуточного стандартного раствора 1 и доводят объём до метки на колбе н-гексаном. Полученному раствору приписывают концентрацию 0,25 мкг/см³.

Процедура приготовления промежуточного стандартного раствора 2 одинакова для всех пестицидов.

Растворы хранят в холодильнике не более 3 мес.

6.2.4 Рабочие стандартные растворы смеси пестицидов

Растворы смеси пестицидов, дозируемые в хроматограф, готовят из промежуточных стандартных растворов пестицидов в мерных колбах вместимостью 50 см³, отмеряя пипетками в колбу объёмы растворов, указанные в таблицах 4-5. Объём смеси до 50 см³ доводят н-гексаном. Приписываемое каждому пестициду значение его концентрации в смеси указано в таблицах 4-5.

Таблица 4 - Рабочие стандартные растворы пестицидов (смесь 1)

Номер раствора	Состав раствора	Используемый раствор пестицида	Объём раствора, вносимый в мерную колбу, см ³	Концентрация пестицида в смеси, мкг/см ³
1	Гексахлор-бензол	промежуточный 2	0,4	0,002
	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	0,4	0,002
	Бета-ГХЦГ	промежуточный 2	2,0	0,010
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	0,4	0,002
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 2	1,0	0,005
	Трифлуралин	промежуточный 2	1,0	0,005
	4,4'-ДДЕ	промежуточный 2	1,0	0,005
	4,4'-ДДД	промежуточный 2	2,0	0,010
	4,4'-ДДТ	промежуточный 2	4,0	0,020
	Дикофол	промежуточный 2	4,0	0,020

Продолжение табл. 4

Номер раствора	Состав раствора	Используемый раствор пестицида	Объем раствора, вносимый в мерную колбу, см ³	Концентрация пестицида в смеси, мкг/см ³
2	Гексахлорбензол	промежуточный 2	1,0	0,005
	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	1,0	0,005
	Бета-ГХЦГ	промежуточный 2	5,0	0,025
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	1,0	0,005
	Дигидрогептахлор	промежуточный 2	2,4	0,012
	Трифлуралин	промежуточный 2	2,4	0,012
	4,4'-ДДЕ	промежуточный 2	2,4	0,012
	4,4'-ДДД	промежуточный 2	5,0	0,025
	4,4'-ДДТ	промежуточный 1	0,25	0,050
3	Дикофол	промежуточный 1	0,25	0,050
	Гексахлорбензол	промежуточный 2	2,0	0,010
	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	2,0	0,010
	Бета-ГХЦГ	промежуточный 1	0,25	0,050
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	2,0	0,010
	Дигидрогептахлор	промежуточный 2	5,0	0,025
	Трифлуралин	промежуточный 2	5,0	0,025

Продолжение табл. 4

Номер раствора	Состав раствора	Используемый раствор пестицида	Объем раствора, вносимый в мерную колбу, см ³	Концентрация пестицида в смеси, мкг/см ³
3	4,4'-ДДЕ	промежуточный 2	5,0	0,025
	4,4'-ДДД	промежуточный 1	0,25	0,050
	4,4'-ДДТ	промежуточный 1	0,5	0,10
	Дикофол	промежуточный 1	0,5	0,10
4	Гексахлор-бензол	промежуточный 2	4,0	0,020
	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	4,0	0,020
	Бета-ГХЦГ	промежуточный 1	0,5	0,10
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	4,0	0,020
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 1	0,25	0,050
	Трифлуралин	промежуточный 1	0,25	0,050
	4,4'-ДДЕ	промежуточный 1	0,25	0,050
	4,4'-ДДД	промежуточный 1	0,5	0,10
	4,4'-ДДТ	промежуточный 1	1,0	0,20
	Дикофол	промежуточный 1	1,0	0,20
	Гексахлор-бензол	промежуточный 1	0,25	0,050
	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 1	0,25	0,050
	Бета-ГХЦГ	промежуточный 1	1,5	0,30

Продолжение табл. 4

Номер раствора	Состав раствора	Используемый раствор пестицида	Объем раствора, вносимый в мерную колбу, см ³	Концентрация пестицида в смеси, мкг/см ³
5	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 1	0,25	0,050
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 1	0,75	0,150
	Трифлуралин	промежуточный 1	0,75	0,150
	4,4'-ДДЕ	промежуточный 1	0,75	0,150
	4,4'-ДДД	промежуточный 1	1,5	0,30
	4,4'-ДДТ	промежуточный 1	2,5	0,50
	Дикофол	промежуточный 1	2,5	0,50

Таблица 5 - Рабочие стандартные растворы пестицидов (смесь 2)

Номер раствора	Состав раствора	Используемый раствор пестицида	Объем раствора, вносимый в мерную колбу, см ³	Концентрация пестицида в смеси, мкг/см ³
1	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	0,4	0,002
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	0,4	0,002
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 2	1,0	0,005
2	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	1,0	0,005
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	1,0	0,005
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 2	2,4	0,012

Продолжение табл. 5

Номер раствора	Состав раствора	Используемый раствор пестицида	Объем раствора, вносимый в мерную колбу, см ³	Концентрация пестицида в смеси, мкг/см ³
3	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	2,0	0,010
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	2,0	0,010
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 2	5,0	0,025
4	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 2	4,0	0,020
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 2	4,0	0,020
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 1	0,25	0,050
5	Альфа-ГХЦГ	промежуточный 1	0,25	0,050
	Гамма-ГХЦГ	промежуточный 1	0,25	0,050
	Дигидрогепта-хлор	промежуточный 1	0,75	0,150

Рабочие стандартные растворы смесей пестицидов хранят в холодильнике не более 3 мес.

6.2.5 Стандартные растворы пестицидов в ацетоне

При определении коэффициентов пересчёта (7.6) или в целях внутреннего контроля для внесения добавки стандартного раствора смеси пестицидов в пробу воды основные и промежуточные стандартные растворы пестицидов, а также рабочие стандартные растворы их смесей, готовят аналогично описанному выше (6.2.1-6.2.4), используя в качестве растворителя ацетон (марка ос.ч.). В этом случае дозируемый в хроматограф стандартный раствор смеси пестицидов в н-гексане готовят следующим образом.

В мерный цилиндр с притёртой пробкой вместимостью 10 см^3 вносят пипеткой 1 см^3 н-гексана и 1 см^3 стандартного раствора смеси пестицидов в ацетоне и перемешивают содержимое цилиндра, не переворачивая его. Затем добавляют в цилиндр очищенную н-гексаном дистиллированную воду до общего объёма смеси 10 см^3 , закрывают цилиндр пробкой и перемешивают смесь встряхиванием в течение 0,5-1,0 мин. Дают смеси расслоиться и используют верхний гексановый слой в качестве стандартного раствора смеси пестицидов в н-гексане. Полученную смесь хранят в холодильнике не более 5 сут.

Условия и сроки хранения растворов пестицидов в ацетоне аналогичны таковым для растворов в н-гексане (6.2.1- 6.2.4).

6.3 Подготовка хроматографических колонок

Стеклянные хроматографические колонки внутренним диаметром 3 мм и длиной 2 м промывают последовательно ацетоном и н-гексаном, сушат при температуре 110-120 °С в сушильном шкафу и заполняют одну колонку носителем с неподвижной фазой SE-30 или OV-17 (4.2.2), другую колонку - носителем с фазой ХЕ-60 (4.2.3).

Для заполнения хроматографической колонки один ее конец, который в дальнейшем будет подсоединяться к детектору, закрывают тампоном из промытого ацетоном и н-гексаном стекловолокна и присоединяют к вакуумному насосу через мелкую капроновую сетку. Затем включают насос и заполняют колонку носителем с фазой, добавляя последний небольшими порциями и постукивая колонку палочкой с резиновым концом при постоянно работающем насосе, следя за тем, чтобы носитель заполнял колонку равномерно, без разрывов.

Заполненную колонку закрывают тампоном из промытой стеклоткани и помещают в термостат колонок хроматографа, подсоединив к испарителю, но не подсоединяя к детектору. Кондиционирование колонки целесообразно проводить следующим образом. Установив расход азота через колонку $40\text{-}50\text{ см}^3/\text{мин}$, выдерживают колонку при температуре 60-70 °С в течение 20-30 мин. Затем поднимают температуру термостата колонок со скоростью 2

-3 град/мин до температуры 230 °С и при этой температуре кондиционируют колонку в течение 8-10 ч.

6.4 Подготовка хроматографов

Подготовку хроматографов проводят в соответствии с инструкцией по их эксплуатации. После кондиционирования колонок их подсоединяют также и к детекторам, устанавливают расход газ-носителя (азота) через колонки 30-40 см³/мин и проверяют герметичность соединений.

Устанавливают необходимый режим работы хроматографов (7.5). После выхода приборов на рабочие режимы вводят несколько раз, по 4-5 мм³ рабочих стандартных растворов смесей пестицидов (6.2.4) и проверяют эффективность хроматографирования последних.

6.5 Подготовка оборудования для микроэкстракции

6.5.1 Устройство для микроэкстракции

Микроэкстракцию (однократное извлечение пестицидов из пробы воды 2,5 см³ н-гексана) производят с помощью устройства, представленного на рисунок 3. Для наиболее полного отделения малых количеств экстракта последний вытесняют вверх, добавляя после разделения слоев в основную делительную воронку (поз. 3, рисунок 3) необходимое количество воды из вспомогательной делительной воронки (поз. 7, рисунок 3).

Для сборки устройства надевают на горло основной делительной воронки проволочное кольцо с усиками (поз. 2, рисунок 3), с помощью которого пружинками или резиновыми кольцами осуществляется фиксация пробки-крана (4.1.24; поз. 1, рисунок 3), и соединяют пробку-кран и вспомогательную воронку фторопластовой трубкой, изогнутой соответственно пробке-крану. Соединение фторопластовой трубки со стеклом осуществляется встык с помощью отрезков силиконовой трубки длиной 15-20 мм. Соединение и разъем должны быть выполнимы без усилий во избежание поломки стеклянных элементов устройства.

6.5.2 Подготовка пипетки для отбора микроэкстрактов

Пипетка для отбора микроэкстрактов представляет собой отрезок трубки из силиконовой резины диаметром 5-6 мм, который с одного конца закрыт отрезком стеклянной палочки длиной 5-6 мм (рисунок 2в). С другого конца в отрезок трубки вставляют сменные капилляры (4.1.30).

После отбора микроэкстракта одной пробы в пипетке меняют использованный капилляр на другой, чистый, и после этого пипеткой осуществляют отбор микроэкстракта другой пробы.

6.6 Подготовка дозатора пипеточного

На наконечник дозатора (4.1.5) вместо полиэтиленовой насадки одевают отрезок силиконовой трубки длиной 15 мм. В свободный конец отрезка трубки вставляют такой же капилляр, как и в пипетку для отбора микроэкстрактов.

6.7 Приготовление фильтра для очистки воздуха

Используемый для упаривания экстрактов воздух (7.2.4, 7.3.2, 7.4) необходимо очищать, пропуская через фильтр с активным углем. В качестве фильтра применяют склянку для очистки газов (4.1.32). Входной отросток склянки заполняют медицинской ватой и наполняют склянку активным углем. При этом выходную часть склянки наполняют активным углем так, чтобы его уровень не доходил до выходного отростка, примерно, на 2 см. Оставшуюся незаполненной углем выходную часть склянки заполняют медицинской ватой. После этого входной отросток склянки соединяют с аквариумным микрокомпрессором, а выходящий из выходного отростка очищенный воздух используют для упаривания экстрактов.

7 Выполнение измерений

7.1 Холостое измерение

Холостое измерение проводят перед анализом проб воды с целью проверки чистоты применяемых реактивов и материалов.

Для выполнения холостого измерения берут 0,8-1,0 дм³ дистиллированной воды, очищенной н-гексаном (6.1.1), тот же объем растворителя, который расходуется на экстракцию одной пробы воды и проводят последовательно все операции анализа в зависимости от выбранного варианта методики (см. 7.2.1-7.2.4 или 7.3.1 - 7.3.2, а также 7.4).


Если пики на хроматограмме холостого опыта совпадают по временам удерживания хотя бы с одним пиком какого-либо из определяемых пестицидов, то необходимо путём постадийного исследования установить какой из реактивов загрязнён и провести его очистку или заменить этим же реактивом, но из другой партии.

7.2 Выполнение измерений по варианту 1

7.2.1 Экстракционное извлечение пестицидов

Нефильтрованную пробу воды объёмом 0,8-1,0 дм³ переносят из транспортной тары в делительную воронку вместимостью 1 дм³. Дважды ополаскивают транспортную тару объёмами по 10 см³ ацетоном и переносят смывы в делительную воронку. Добавляют в делительную воронку 20 см³ н-гексана и выполняют экстрагирование, встряхивая пробу 3 мин и затем ожидая расслоения смеси 15-30 мин. Затем водную фазу переносят в химический стакан, а гексановый экстракт - в колбу с притёртой пробкой. Пробу воды возвращают в делительную воронку и ещё раз экстрагируют н-гексаном объёмом 20 см³. Пробу воды после расслоения отбрасывают, а гексановый экстракт объединяют с первым экстрактом.

К объединённому гексановому экстракту при непрерывном помешивании добавляют безводный сульфат натрия в количестве 2-5 г

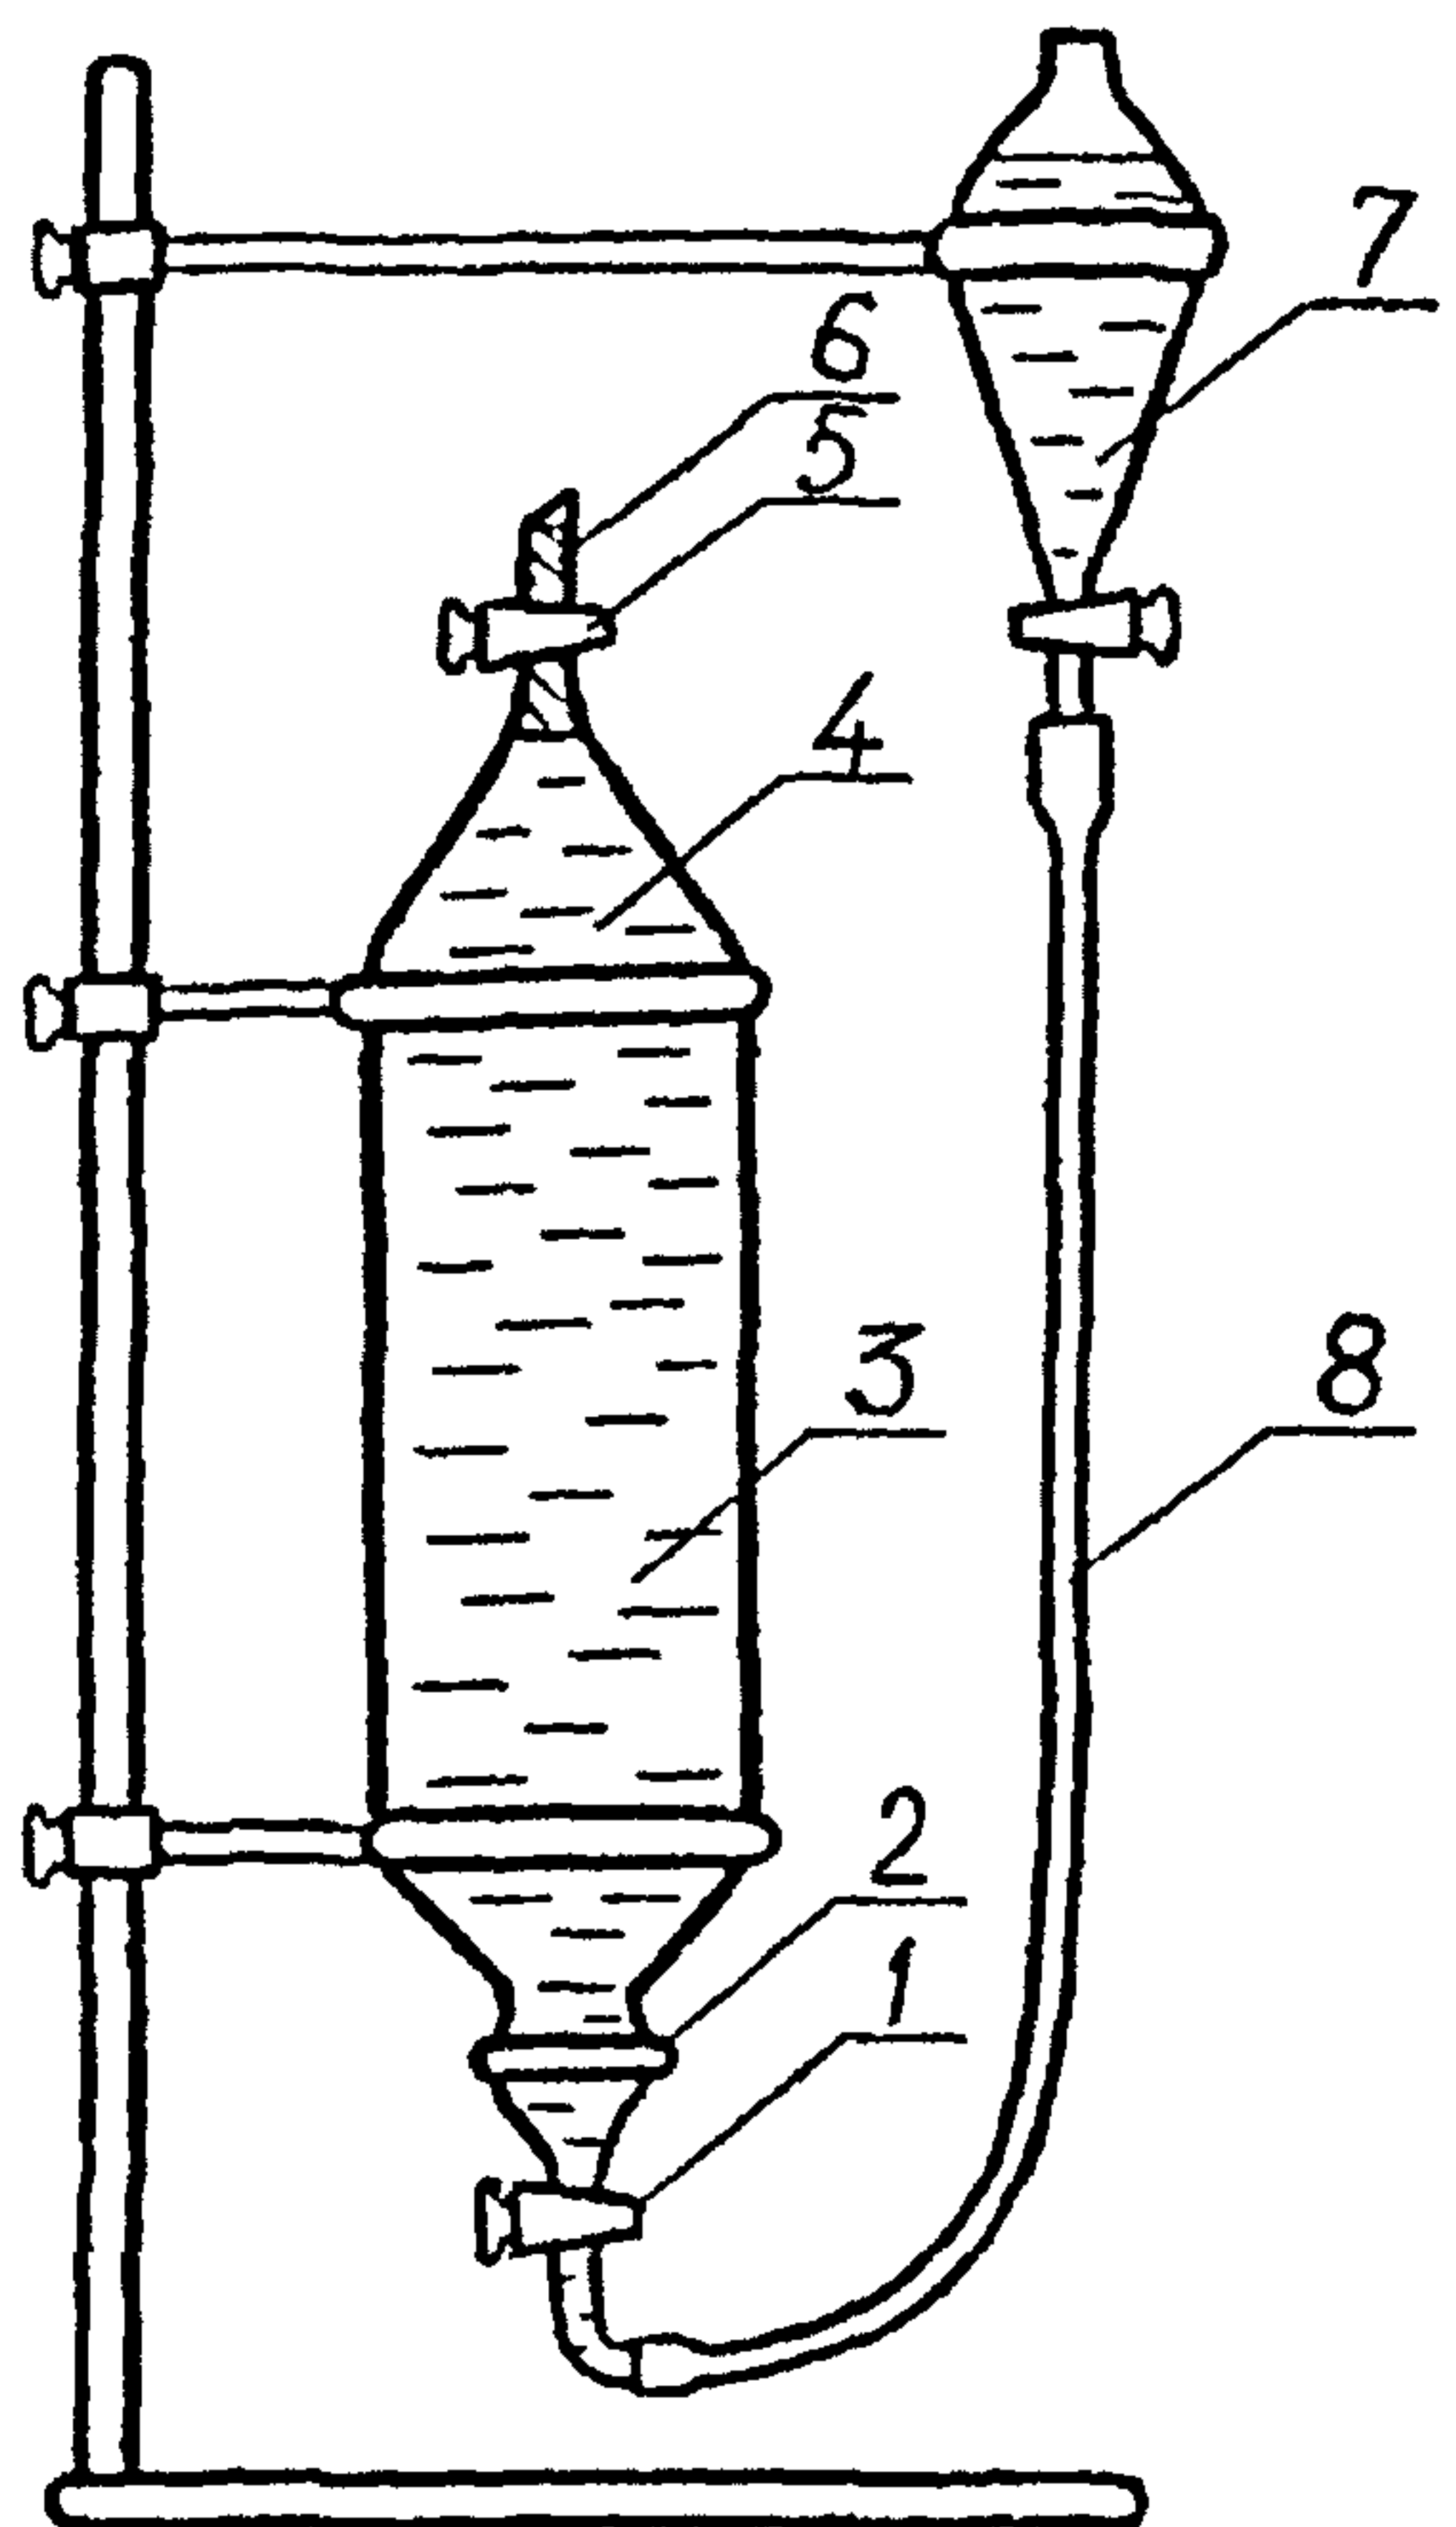

1 - пробка-кран, 2 - кольцо для фиксации пробки-крана,
3 - делительная воронка, 4 - водный слой, 5 - сливной кран,
6 - гексановый экстракт, 7 - вспомогательная воронка,
8 - фторопластовая трубка, 9 - штатив

Рисунок 3 - Схема устройства для микроэкстракции

(в зависимости от степени эмульгированности экстракта) и затем фильтруют экстракт через слой безводного сульфата натрия (примерно, 3-4 г), помещенного в воронку на подложку из обезжиренной ваты и предварительно смоченного н-гексаном до появления первой капли.

Делительную воронку ополаскивают внутри н-гексаном объёмом 8-10 см³, переносят эту порцию н-гексана из делительной воронки в колбу, в которой был объединённый экстракт, обмывают ею стенки колбы и находящийся в колбе сульфат натрия и также фильтруют через слой сульфата натрия в воронке. Колбу и находящийся в ней сульфат ещё раз ополаскивают 8-10 см³ н-гексана, который затем фильтруют через ту же воронку с сульфатом натрия.

Весь фильтрат (экстракты и промывные порции н-гексана) собирают в аппарат Кудерна-Даниша (4.1.14). Если экстракт необходимо оставить на хранение, то фильтрат собирают в колбу с притёртой пробкой.

7.2.2 Предварительное концентрирование

К аппарату Кудерна-Даниша, содержащему полученный по 7.2.1 гексановый экстракт, подсоединяют дефлегматор и помещают аппарат на водяную баню при температуре 90-95 °С так, чтобы уровень воды в бане доходил до середины шлифа пробирки для концентрата. Необходимо следить, чтобы дефлегматор не охлаждался и кипение не прекращалось (при необходимости - защитить среднюю часть аппарата асбестовым экраном).

Экстракт упаривают в этих условиях до объёма, примерно, 0,5 см³.

Удаление растворителя длится 10-20 мин. Затем аппарат извлекают из водяной бани и охлаждают на воздухе. Дефлегматор и среднюю часть аппарата обмывают изнутри 2 - 3 см³ н-гексана и отсоединяют пробирку с концентратом. Общий объём концентрата должен составлять 4-5 см³.

Если фильтрат гексанового экстракта собирали в колбу с притёртой пробкой (7.2.1), то после перенесения содержимого колбы в аппарат Кудерна-Даниша колбу ополаскивают дважды н-гексаном объёмами по 2-3 см³, промывные порции н-гексана также помещают в аппарат Кудерна-Даниша и после этого осуществляют концентрирование.

Вместо аппарата Кудерна-Даниша концентрирование экстрактов

можно проводить в колбах с Г-образным отводом (4.1.14) на водяной бане с температурой 75-80 °С или с помощью ротационного испарителя (температура бани около 35 °С).

7.2.3 Очистка экстрактов

Сконцентрированный по 7.2.2 экстракт количественно переносят в делительную воронку вместимостью 10 см³, приливают пипеткой 1 см³ концентрированной серной кислоты, несколько раз аккуратно переворачивают делительную воронку и дают смеси расслоиться. Обработку экстракта серной кислотой повторяют, меняя последнюю до тех пор, пока слой кислоты не будет оставаться бесцветным.

Всю кислоту, пошедшую на обработку экстракта собирают в пробирку вместимостью 10 см³ для последующего определения трифлуралина (7.4).

Обработанный серной кислотой экстракт промывают последовательно 2-3 см³ дистиллированной воды, очищенной н-гексаном, 1-2 раза по 2-3 см³ 0,5 % раствором гидрокарбоната натрия (6.1.4) до отсутствия кислой реакции по универсальной индикаторной бумаге и снова 2 раза дистиллированной водой.

7.2.4 Окончательное концентрирование экстрактов

Очищенный по 7.2.3 экстракт переносят в градуированную пробирку вместимостью 10 см³. Делительную воронку, в которой осуществляли очистку экстракта (7.2.3), обмывают изнутри дважды н-гексаном объёмами по 0,5 см³ и промывные порции н-гексана объединяют с экстрактом в пробирке. Содержащийся в пробирке экстракт упаривают до объёма, примерно, 1,5 см³ струёй азота или воздуха (воздух очищают с помощью фильтра, см. 6.7). Затем в пробирку доливают 7-8 см³ дистиллированной воды, очищенной н-гексаном, доводят объём экстракта точно до 1,5 см³ дальнейшим упариванием струёй азота (воздуха) или добавлением по каплям н-гексана и хроматографируют по 7.5 аликвоту объёмом 5-6 мм³ или закрывают пробирку притёртой пробкой и оставляют на хранение.

7.3 Выполнение измерений по варианту 2

7.3.1 Микроэкстракционное извлечение пестицидов

В основную делительную воронку установки для микроэкстракции (рисунок 3) вместимостью 1 дм^3 с помощью мерного цилиндра помещают нефльтрованную пробу воды объёмом $0,8-1,0 \text{ дм}^3$, $80-100 \text{ см}^3$ раствора сульфата натрия (6.1.3) и $2,0-2,5 \text{ см}^3$ н-гексана. Закрывают делительную воронку пришлифованной пробкой-краном, закрепляют пробку-кран с помощью пружинок или резиновых колец и энергично экстрагируют пробу в течение 3 мин, затем основную делительную воронку помещают в штатив установки сливным отростком вверх. После расслоения фаз (через 15-30 мин) соединяют пробку-кран с уравнительной трубкой, подсоединённой другим концом к сливному отростку вспомогательной делительной воронки, и вытесняют экстракт вместе с эмульсией через сливной кран основной делительной воронки в её сливной отросток. Экстракт вместе с эмульсией отбирают пипеткой-капельницей (рисунок 2в), переносят в градуированную пробирку вместимостью 5 см^3 , закрывают пробирку пришлифованной пробкой и центрифугируют в течение 5 мин при 3000 об/мин.

В случае, если после центрифугирования значительная часть гексанового экстракта находится в виде эмульсии, осторожно круговыми движениями перемешивают экстракт с помощью пипетки опустив в экстракт капилляр. Налипшую на кончик капилляра гелеобразную массу удаляют из пробирки и, в случае необходимости, повторяют центрифугирование.

7.3.2 Очистка экстрактов

В делительную воронку вместимостью 10 см^3 с помощью дозатора пипеточного (6.6) помещают $1,5 \text{ см}^3$ экстракта, полученного по 7.3.1. Туда же приливают 1 см^3 концентрированной серной кислоты и осторожно встряхивают делительную воронку несколько раз. Дают слоям разделиться и удаляют из делительной воронки серную кислоту. Если слой серной кислоты окрашен, обработку повторяют. Все порции серной кислоты, пошедшие на очистку экстракта, собирают в пробирку

с притёртой пробкой вместимостью 10 см^3 для дальнейшего определения трифлуралина (7.4).

Обработанный серной кислотой экстракт промывают 2 см^3 дистиллированной воды, очищенной н-гексаном, затем 1-2 раза (до отсутствия кислой реакции по универсальной индикаторной бумаге) 0,5 % раствором гидрокарбоната натрия порциями по 2 см^3 и после этого 2 раза дистиллированной водой объёмами по 2 см^3 .

Отмытый экстракт из делительной воронки с частью воды переносят в градуированную пробирку с притёртой пробкой вместимостью 5 см^3 . Делительную воронку 2 раза обмывают внутри н-гексаном объёмами по $0,3-0,5\text{ см}^3$ и промывные порции н-гексана объединяют с экстрактом в пробирке. Объём очищенного экстракта доводят до $1,5\text{ см}^3$, упаривая струёй азота или очищенного через фильтр (6.7) воздуха или добавляя по каплям н-гексан. После этого аликвоту экстракта объёмом $5-6\text{ мм}^3$ хроматографируют по 7.5 или закрывают пробирку притёртой пробкой и оставляют на хранение.

7.4 Выделение трифлуралина

В делительную воронку вместимостью 100 или 250 см^3 вносят такой объём очищенной н-гексаном дистиллированной воды, который в 30 раз превышает объём пошедшей на очистку экстракта серной кислоты (7.2.4 или 7.3.2). Туда же количественно переносят объединённые порции использованной на очистку экстрактов серной кислоты (5.2.3 или 5.3.2) и перемешивают содержимое делительной воронки. Затем вносят в нее пипеткой $1,5\text{ см}^3$ н-гексана и энергично встряхивают в течение 5 мин. Дают смеси отстояться и отбрасывают водный слой.

Гексановый экстракт переносят в делительную воронку вместимостью 10 см^3 . Делительную воронку, в которой осуществляли экстрагирование трифлуралина, обмывают изнутри дважды н-гексаном объёмами по $0,5-1,0\text{ см}^3$ и промывные порции н-гексана объединяют с экстрактом в делительной воронке вместимостью 10 см^3 . Экстракт промывают очищенной н-гексаном дистиллированной водой, 0,5 % раствором гидрокарбоната натрия, ещё дистиллированной водой, переносят в пробирку с притёртой пробкой вместимостью 5 см^3 и

доводят до объёма $1,5 \text{ см}^3$ так, как это описано в 7.3.2. После этих операций экстракт готов для хроматографирования. Хроматографируют аликвоту объёмом $5-6 \text{ мм}^3$ или закрывают пробирку притёртой пробкой и оставляют на хранение.

7.5 Хроматографирование экстрактов

Хроматографирование экстракта каждой пробы осуществляют на двух хроматографах, один из которых снабжён колонкой с неподвижной фазой SE-30 или OV-17, а другой - колонкой с фазой ХЕ-60.

На хроматографе, снабженном колонкой с фазой ХЕ-60, записывают хроматограмму стандартного раствора смеси 1 (6.2.4). На фазе SE-30 или OV-17 плохо разделяются ГХБ, бета-ГХЦГ и гамма-ГХЦГ, а также дикофол и дигидрогептахлор. Поэтому для лучшей идентификации определяемых пестицидов на хроматографе, снабженном колонкой с фазой SE-30 или OV-17, записывают последовательно хроматограммы стандартных растворов как смеси 1, так и смеси 2.

В испарители обоих хроматографов вводят по $5-6 \text{ мм}^3$ соответствующих стандартных растворов и определяют времена удерживания хроматографических пиков пестицидов. Этот параметр необходимо проверять ежедневно перед началом определения после выхода приборов на рабочий режим.

Затем в испарители обоих хроматографов вводят по $5-6 \text{ мм}^3$ экстракта одной пробы, приготовленного по 7.2.4 или 7.3.2. Трифлуралин определяют, хроматографируя на обоих хроматографах по $5-6 \text{ мм}^3$ экстракта одной пробы, приготовленного по 7.4. Пестициды идентифицируют, сравнивая времена удерживания на хроматограммах пробы с временами удерживания, установленными при хроматографировании стандартных растворов на колонках с соответствующими неподвижными фазами.

Примеры хроматограмм представлены на рисунках 4 и 5.

Условия хроматографирования следует устанавливать для каждого конкретного хроматографа свои, исходя из приведённых ниже:

- температура испарителя $- 220-230 \text{ }^{\circ}\text{C}$;
- температура колонки $- 190-210 \text{ }^{\circ}\text{C}$;


- температура детектора - 270-280 °С;
- расход азота через колонку - 30-40 см³/мин;
- расход азота на поддув детектора - в соответствии с инструкцией по его эксплуатации;
- скорость диаграммной ленты - 240 мм/ч;
- рабочий предел измерений на усилителе - в зависимости от определяемых концентраций;
- объемы вводимых в хроматограф аликвот стандартного раствора и пробы должны быть одинаковы.

Пестицид считается идентифицированным только в том случае, если соответствующий ему пик имеет место на хроматограммах, полученных как на колонке с фазой ХЕ-60, так и на колонке с фазой SE-30 или OV-17. Если, например, на хроматограмме, полученной на колонке с фазой ХЕ-60 имеется пик, соответствующий по времени удерживания 4,4'-ДДЕ, а на хроматограмме, полученной на колонке с фазой SE-30 или OV-17, пик, соответствующий 4,4'-ДДЕ, отсутствует (или в случае обратной ситуации), то делается вывод об отсутствии в пробе воды этого вещества.

При хроматографировании экстрактов проб природной воды необходимо выполнять условие, чтобы концентрации в них пестицидов находилась в пределах аттестованных диапазонов их концентраций (таблицы 2, 3). Если содержание пестицидов в экстракте превышает верхний предел аттестованных диапазонов концентраций, экстракты, полученные по 7.2.4, 7.3.2 и 7.4, разбавляют в соответствующее число раз н-гексаном.


7.6 Определение коэффициентов пересчёта

В процессе проведения анализа происходят некоторые потери пестицидов. Поэтому во избежание получения заниженных результатов в формулу, по которой рассчитывают содержание того или иного пестицида, вводят коэффициент, учитывающий потери этого пестицида в ходе определения (8.1).

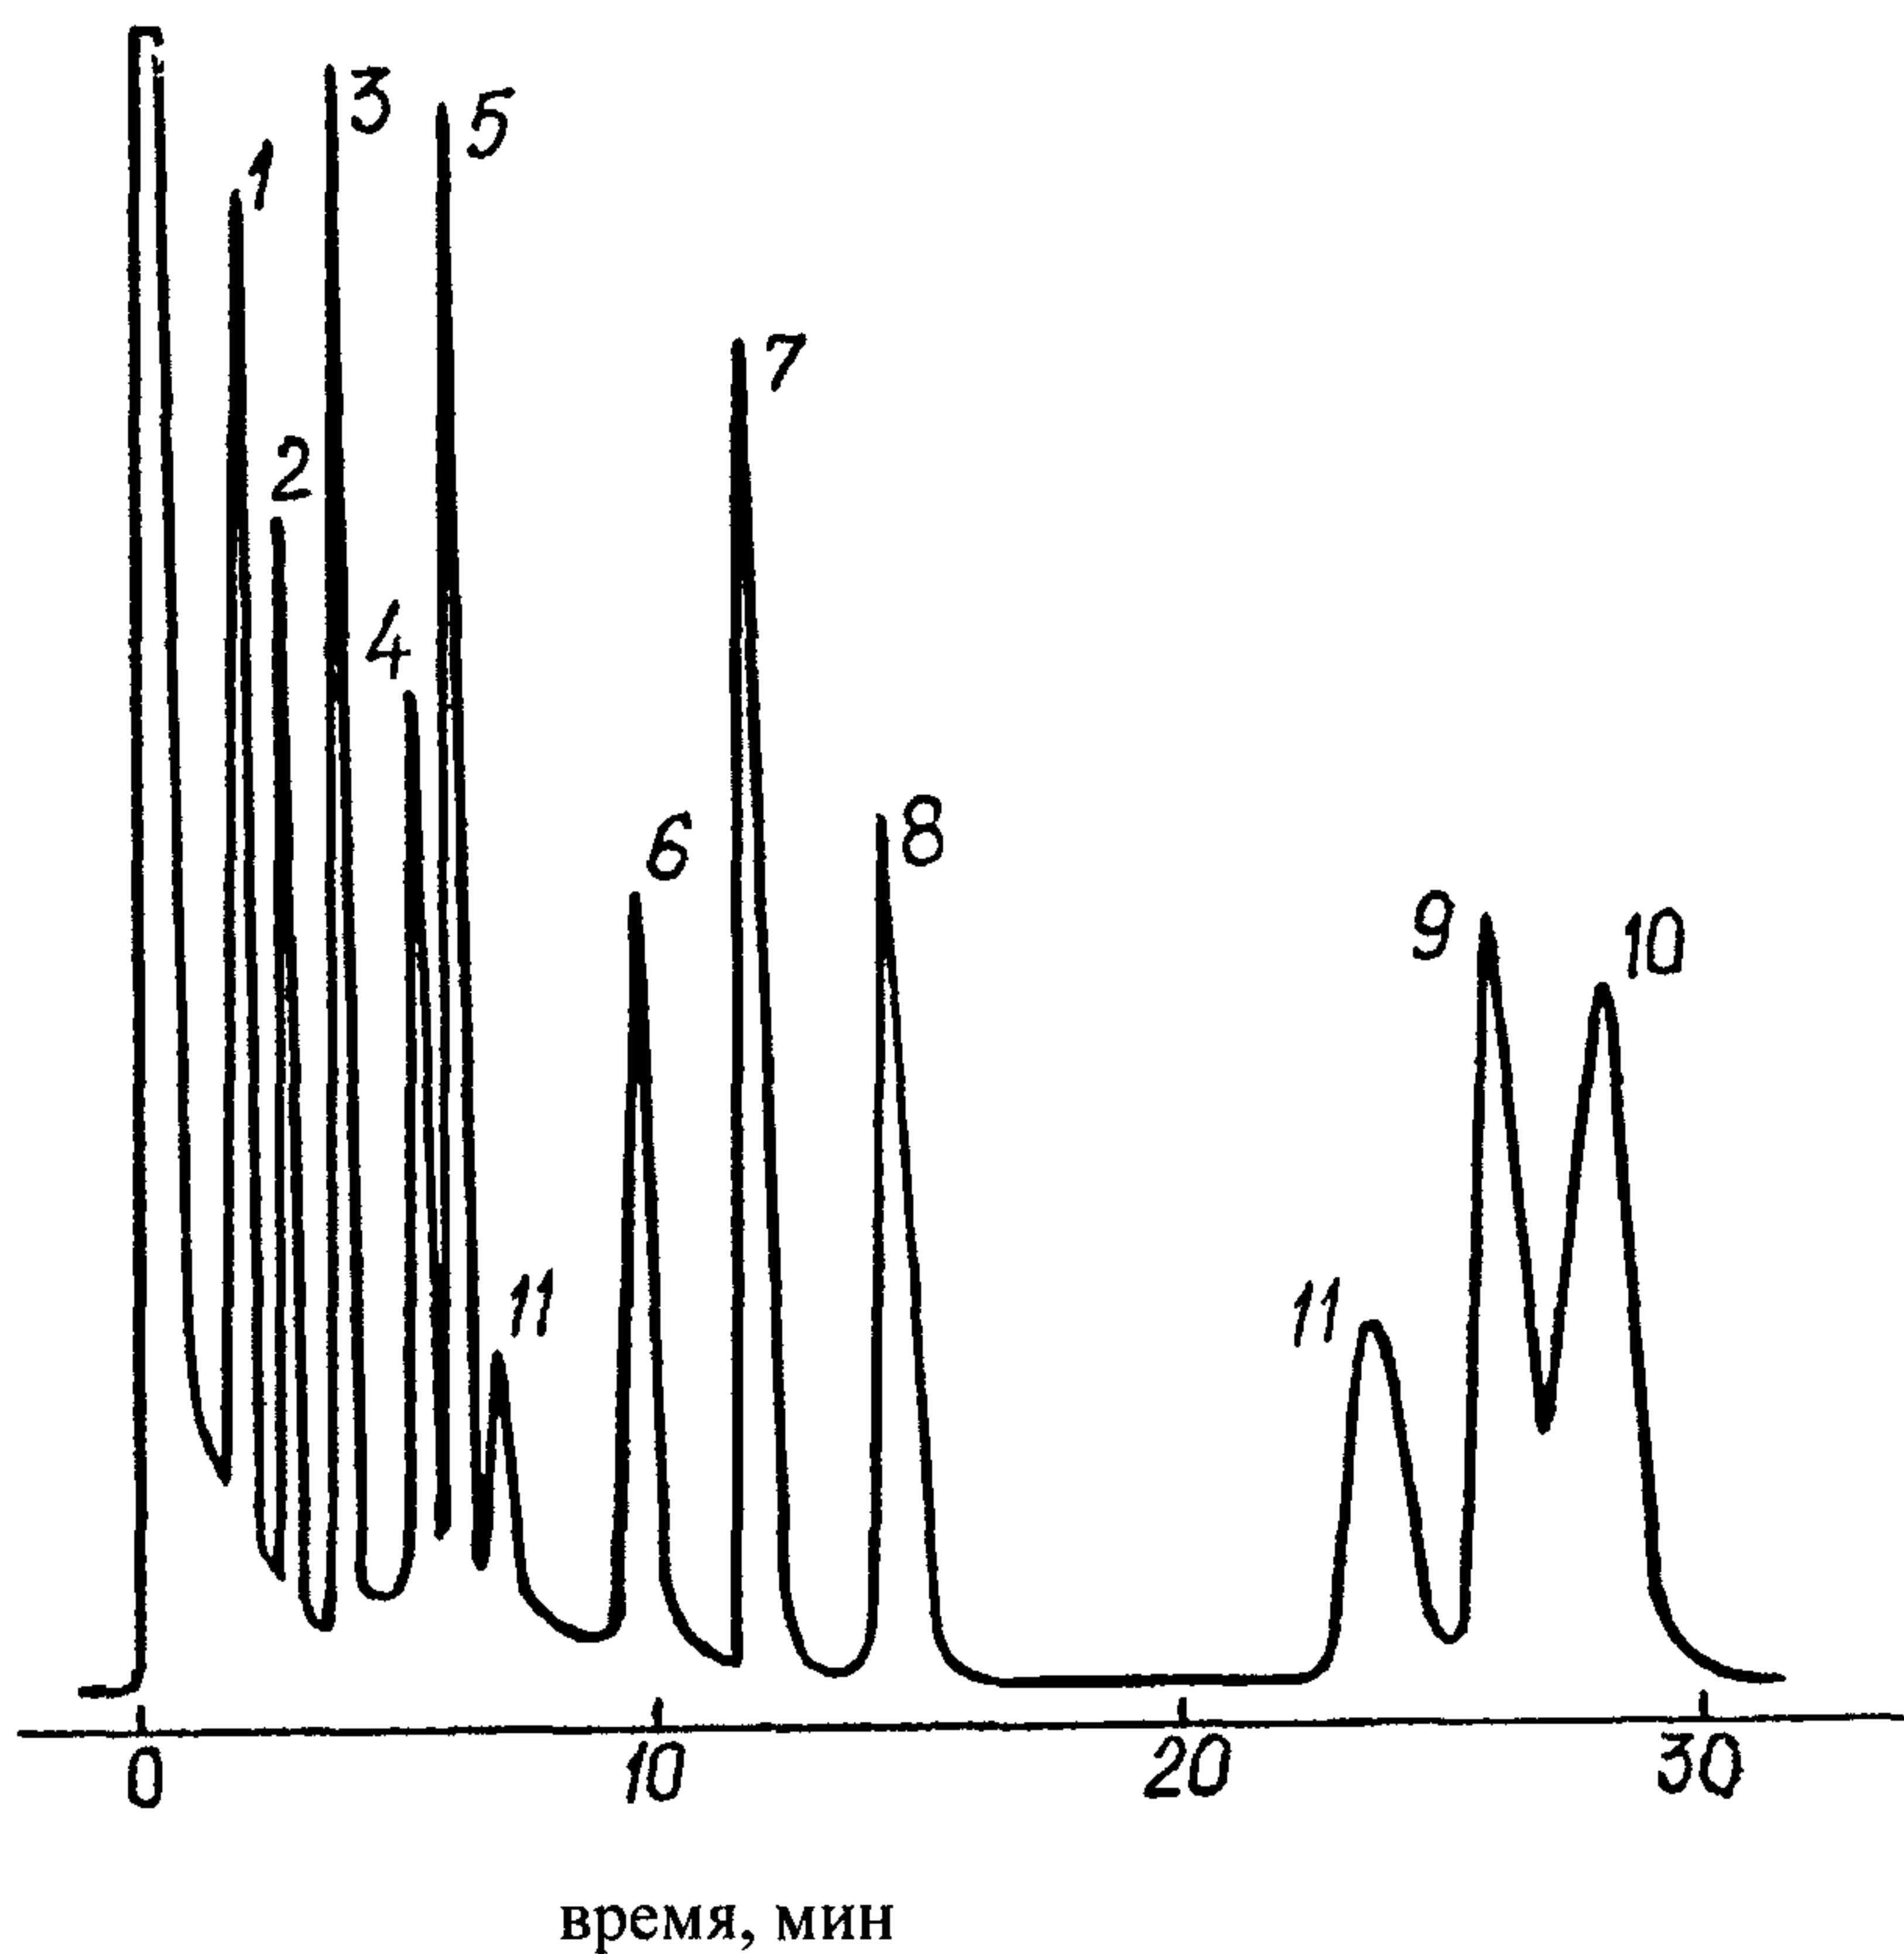

1 - гексахлорбензол, 2 - трифлуралин, 3 - альфа-ГХЦГ, 4 - гамма-ГХЦГ, 5 - дигидрогептахлор, 6 - дикофол, 7 - 4,4'-ДДЕ, 8 - бета-ГХЦГ, 9 - 4,4'-ДДД, 10 - 4,4'-ДДТ, 11 - пики хроматографической системы

Рисунок 4 - Хроматограмма стандартного раствора смеси 1 пестицидов на колонке с неподвижной фазой ХЕ-60

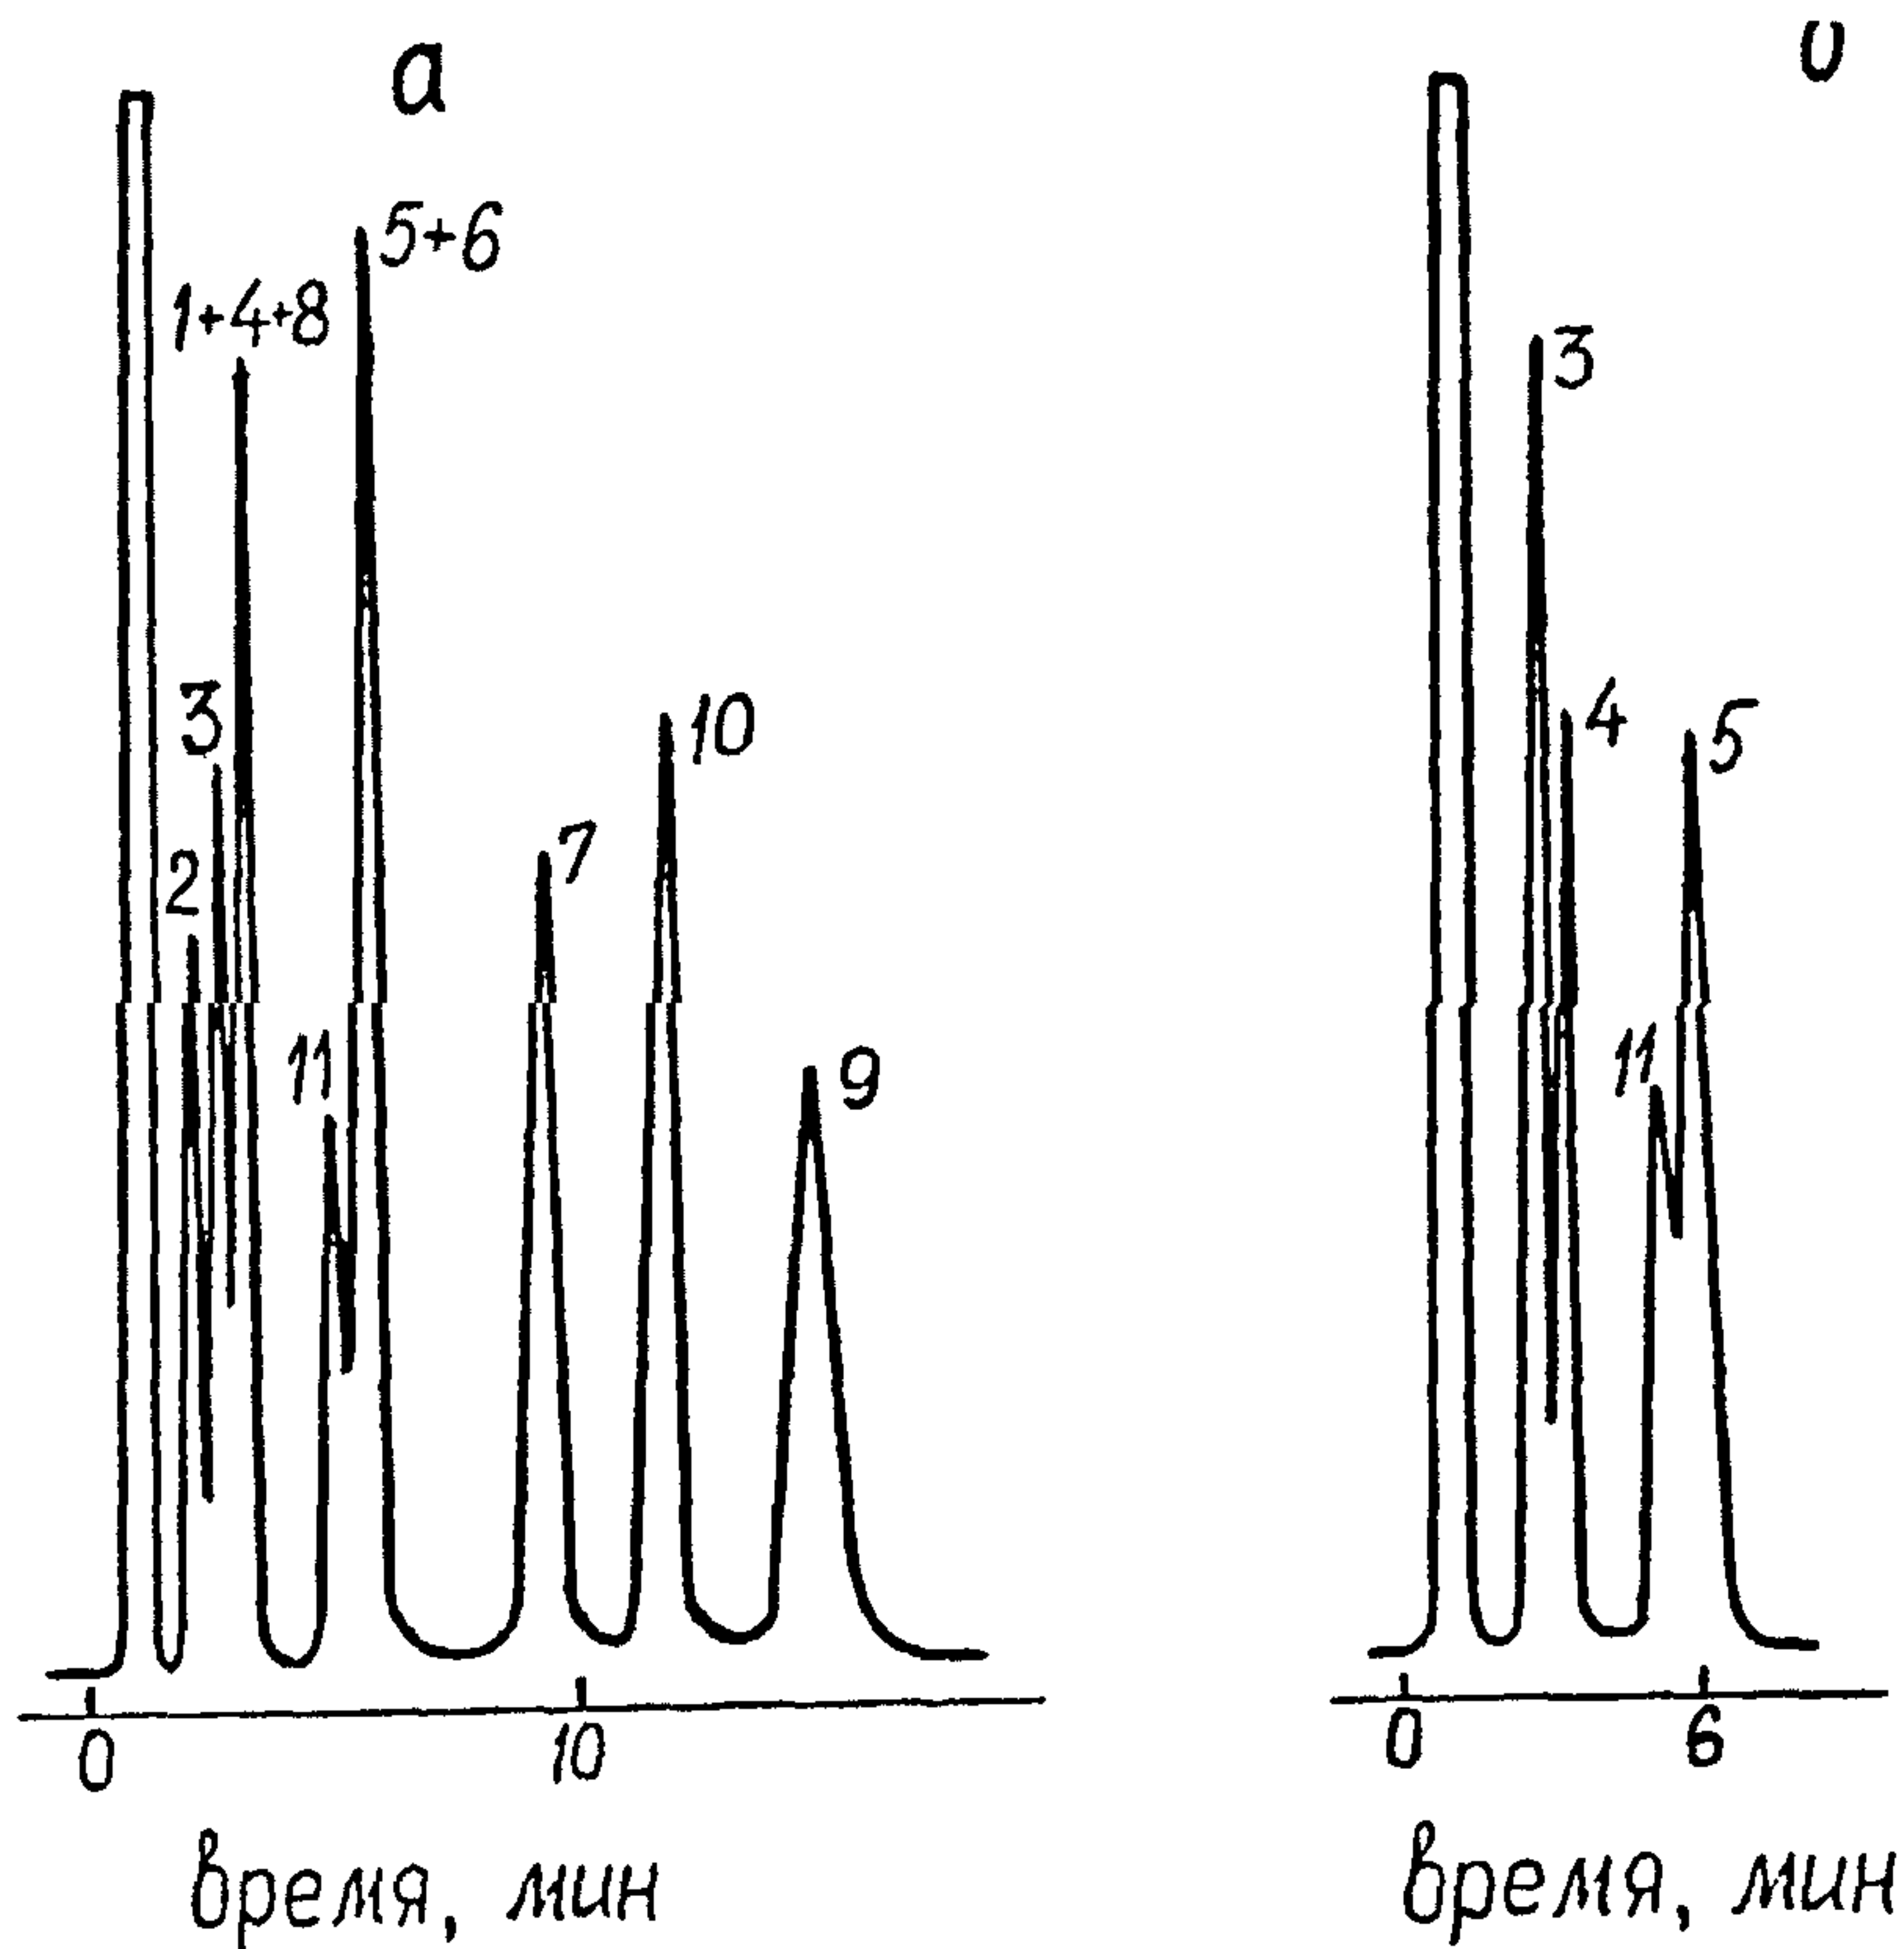

1 - гексахлорбензол, 2 - трифлуралин, 3 - альфа-ГХЦГ,
 4 - гамма-ГХЦГ, 5 - дигидрогептахлор, 6 - дикофол, 7 - 4,4'-ДДЕ,
 8 - бета-ГХЦГ, 9 - 4,4'-ДДД, 10 - 4,4'-ДДТ,
 11 - пики хроматографической системы

Рисунок 5 - Хроматограммы стандартных растворов смеси 1 (а) и смеси 2 (б) пестицидов на колонке с неподвижной фазой SE-30

Величины коэффициентов потерь в той или иной степени зависят от варианта определения (7.2.1-7.2.4 или 7.3.1-7.3.2), от применяемого оборудования для концентрирования экстрактов, а также от состава анализируемой воды. Поэтому коэффициенты пересчёта необходимо определять в каждой лаборатории для различных типов вод и оборудования для концентрирования экстрактов, используя тот вариант определения, который применяется в данной лаборатории.

Для определения коэффициентов пересчёта анализируют две пробы природной воды данного типа объёмом по 0,8 дм³, в одну из которых внесена добавка стандартного раствора смеси 1 в ацетоне (6.2.4) объёмом 1 см³. Анализ проводят по 7.2.1-7.2.4 или 7.3.1-7.3.2 и 7.4 в зависимости от того, какой вариант определения будет применяться. Анализ проб с добавками и без добавок осуществляют в 4-5 повторностях. С водой иного типа анализ проводят вновь.

Коэффициенты пересчёта для каждого пестицида находят по формулам, приведенным в 8.2.

Значения коэффициентов пересчёта (К), полученные при метрологической аттестации настоящей методики, приведены в таблице 6.


Таблица 6 - Ориентировочные коэффициенты пересчёта

Пестицид	Величины коэффициентов пересчёта при определении	
	по варианту 1	по варианту 2
Гексахлорбензол	1,22	1,20
Альфа-ГХЦГ	1,38	1,38
Бета-ГХЦГ	1,59	1,67
Гамма-ГХЦГ	1,38	1,38
Дигидрогептахлор	1,25	1,29
Трифлуралин	1,16	1,18
4,4'-ДДЕ	1,15	1,16
4,4'-ДДД	1,15	1,11
4,4'-ДДТ	1,15	1,13
Дикофол	1,40	1,35

7.7 Устранение мешающих влияний

Использование для очистки экстрактов концентрированной серной кислоты позволяет устранить мешающее влияние большого количества соэкстрагирующихся веществ, в том числе метафоса, фосфамида и др.

Если при хроматографировании экстракта по 7.5 наблюдается значительная перегрузка начальной части хроматограммы в области выхода пиков альфа- и гамма-ГХЦГ (рисунок 6), осуществляют дополнительную очистку экстракта от элементарной серы и (или) содержащих серу соединений.

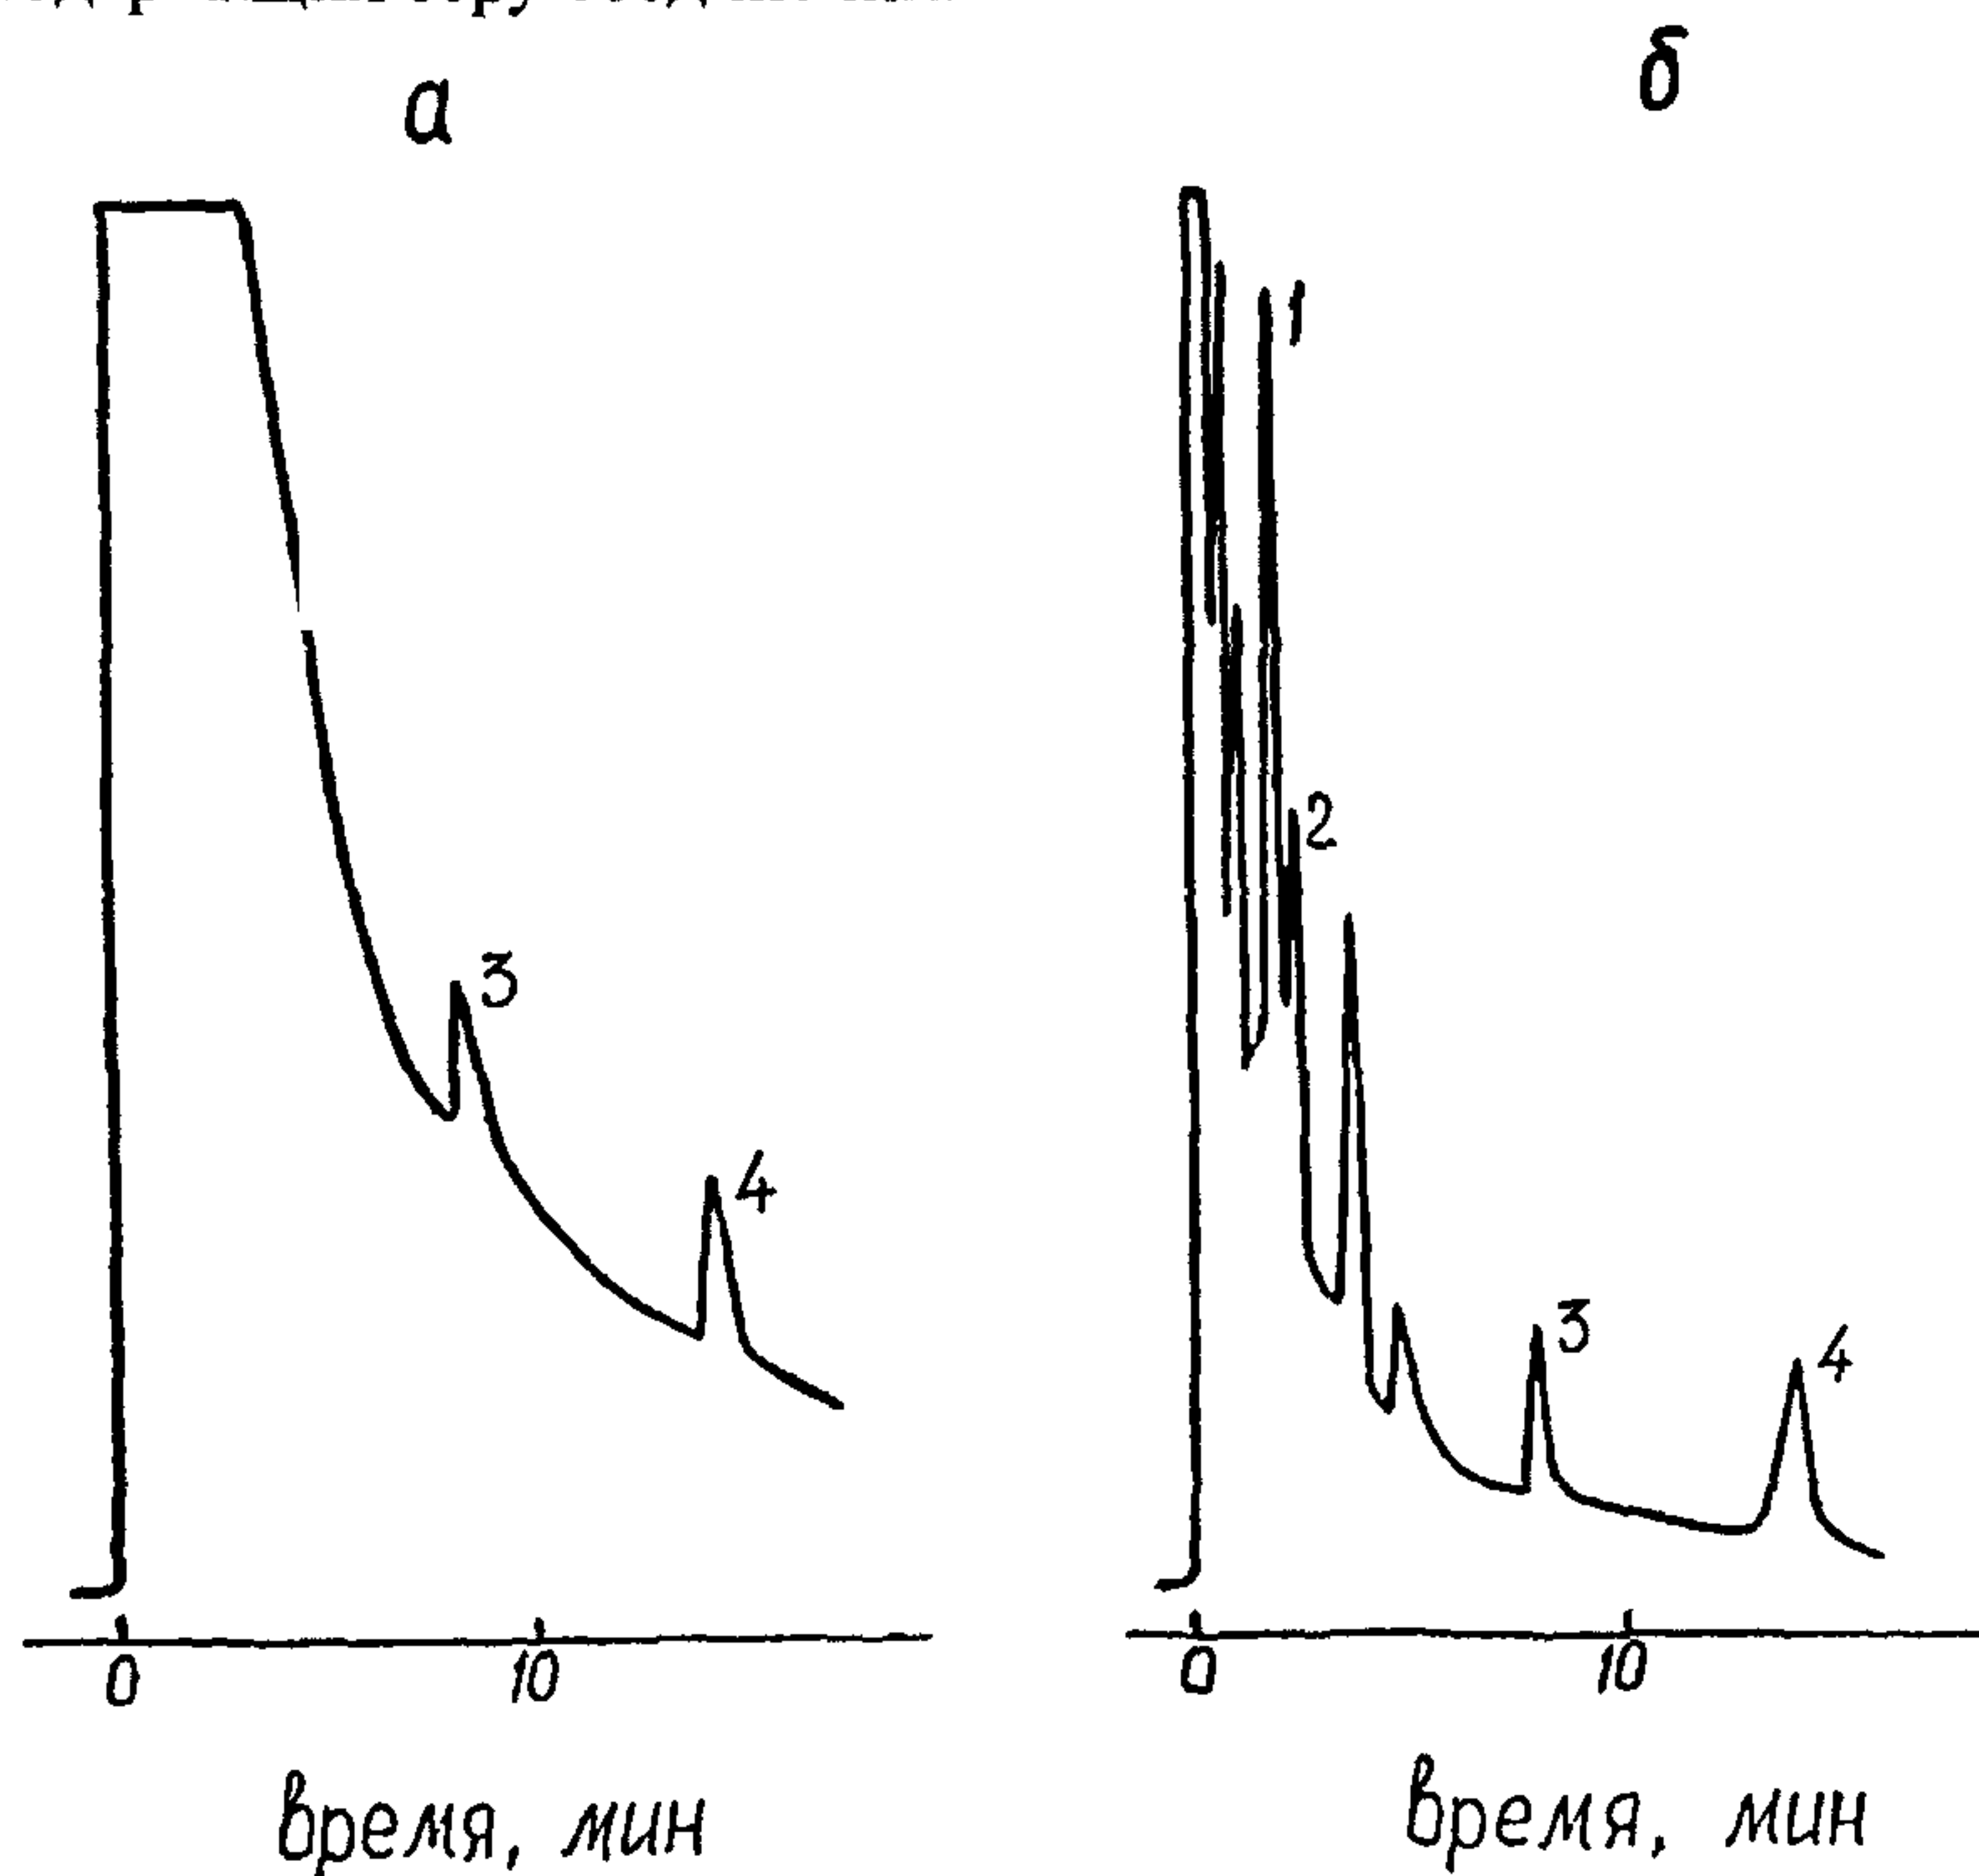

1 - альфа-ГХЦГ, 2 - гамма-ГХЦГ, 3 - 4,4'-ДДЕ, 4 - 4,4'-ДДТ

Рисунок 6 - Хроматограммы экстракта из природной воды, содержащей сероводород, до (а) и после (б) её обработки активированной медью

Очистка от элементарной серы и содержащих серу соединений с помощью ТБА в присутствии сульфита натрия. С помощью дозатора (6.6) очищенный серной кислотой экстракт в количестве 1 см^3 вносят в делительную воронку вместимостью 10 см^3 . Затем в делительную воронку добавляют пипеткой 1 см^3 изопропилового спирта и 1 см^3 раствора ТБА (6.1.5). Содержимое воронки встряхивают в течение 1 мин.

Если при этом сульфит натрия, содержащийся в растворе ТБА, не выпадает в осадок, то его добавляют к смеси в делительной воронке порциями примерно по 100 мг до тех пор, пока добавленная порция не выпадет в осадок. После этого к содержимому в делительной воронке добавляют 5 см^3 дистиллированной воды, очищенной н-гексаном, встряхивают и нижний водный слой отделяют, сливая его в химический стакан вместимостью 50 см^3 . Гексановый экстракт фильтруют через предварительно смоченный н-гексаном сульфат натрия (2-3 г) в градуированную пробирку с притёртой пробкой вместимостью 10 см^3 . Слой сульфата натрия промывают $1,0-1,5\text{ см}^3$ н-гексана. Водный слой возвращают в делительную воронку и экстрагируют ещё раз 3 см^3 н-гексана. После этого водный слой отбрасывают, а гексановый экстракт фильтруют через ту же порцию сульфата натрия. Слой сульфата натрия промывают $1,0-1,5\text{ см}^3$ н-гексана. Очищенный экстракт концентрируют под струёй азота или воздуха до 1 см^3 и хроматографируют.

Очистка от элементарной серы и содержащих серу соединений активированной медью. С помощью дозатора (6.6) 1 см^3 очищенного серной кислотой экстракта вносят в градуированную пробирку с притёртой пробкой вместимостью 5 см^3 и добавляют туда небольшое количество (на кончике скальпеля) активированной меди (6.1.8). Закрывают пробирку пробкой и оставляют на 15-20 мин, периодически встряхивая пробирку, но не переворачивая.

Если вся добавленная порция меди покрылась черным налётом, добавляют в пробирку с экстрактом ещё порцию меди и вновь оставляют, периодически встряхивая пробирку (если сплошное почернение медных опилок или крупки происходит ранее, чем через 15-20 мин, то новую порцию добавляют, не ожидая истечения этого времени). Медь добавляют до тех пор, пока очередная её порция через

15-20 мин после добавления не останется без изменений или только немного потемнеет (экстракт при этом зачастую мутнеет от образующегося сульфида меди).

По завершении процесса очистки экстракта в пробирку приливают 2-3 см³ дистиллированной воды, очищенной н-гексаном, закрывают пробирку пробкой и центрифугируют в течение 0,5-1 мин при 3000 об/мин. Объём доводят до 1 см³ н-гексаном и хроматографируют.

Щелочное дегидрохлорирование. В пробах воды наряду с определяемыми пестицидами могут присутствовать ПХБ, галоваксы, терфенилы и подобные группы соединений. Это проявляется, как правило, в регистрации на хроматограмме большого количества пиков, по временам удерживания зачастую совпадающих с пиками определяемых пестицидов, а также пиков с временами удерживания большими, чем время удерживания 4,4'-ДДТ. В таких случаях экстракты подвергают щелочному дегидрохлорированию.

Для щелочного дегидрохлорирования 1 см³ гексанового экстракта, очищенного серной кислотой (7.2.4 или 7.3.2) и, если необходимо, от сернистых соединений (см. выше) помещают в плоскодонную коническую колбу со шлифом вместимостью 25 см³, добавляют 0,4-0,5 г плавленого гидроксида калия (4-5 гранул) и 2 см³ этилового спирта. К колбе подсоединяют обратный холодильник и помещают её на нагретую до температуры 50-55 °С магнитную мешалку. Содержимое колбы нагревают перемешивая при этой температуре в течение 30 мин с момента растворения гранул гидроксида калия. В качестве перемешивающего элемента используют активатор из железного стержня, запаянного в стеклянную трубку длиной 10-20 мм и диаметром 3-5 мм.


После окончания нагревания колбу вместе с холодильником приподнимают над магнитной мешалкой. Через 5-10 мин колбу отсоединяют от холодильника и промывают 3-5 см³ н-гексана из пипетки внутреннюю часть холодильника и внешнюю часть его шлифа, собирая промывную порцию н-гексана в реакционную колбу. Содержимое колбы переносят в делительную воронку вместимостью 25 см³, колбу ополаскивают 2 см³ н-гексана, смывая его в ту же делительную воронку. Туда же добавляют 10 см³ дистиллированной

воды, очищенной н-гексаном и перемешивают, переворачивая делительную воронку. После разделения слоёв нижний водно-спиртовый слой сливают в исходную (реакционную) колбу, а гексановый экстракт в другую делительную воронку. Водно-спиртовый слой возвращают в первую делительную воронку и повторно экстрагируют 2-3 см³ н-гексана. Объединённый гексановый экстракт во второй делительной воронке промывают дважды 1 % раствором серной кислоты объёмами по 2 см³, а затем очищенной н-гексаном дистиллированной водой и 0,5 % раствором гидрокарбоната натрия до отсутствия кислой реакции по универсальной индикаторной бумаге и опять дистиллированной водой. Полученный таким образом гексановый экстракт сушат фильтрованием через 2-3 г безводного сульфата натрия, упаривают струёй азота или воздуха при комнатной температуре до объёма 1 см³ и хроматографируют.

Пример хроматограмм экстракта пробы воды до и после дегидрохлорирования представлен на рисунке 7.

Щелочное дегидрохлорирование осуществляют с идентификационными целями. В процессе дегидрохлорирования от молекул ГХЦГ, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДД, дигидрогептахлора отщепляются молекулы HCl. Это приводит к тому, что после дегидрохлорирования аналитические сигналы (пики), соответствующие альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДД, дигидрогептахлору, на хроматограмме исчезают. При этом пик 4,4'-ДДЭ в той или иной степени возрастает за счёт образования этого соединения из 4,4'-ДДТ.

Если же в пробе воды присутствуют галоваксы, ПХБ, терфенилы, молекулы которых в условиях щелочного дегидрохлорирования не изменяются, и пики этих соединений на хроматограммах совпадают с пиками определяемых пестицидов, то после дегидрохлорирования аналитические сигналы, отвечающие альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДД или дигидрогептахлору, останутся неизменными или несколько уменьшенными. Таким образом, идентификацию того пестицида (альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДД или дигидрогептахлора), пик которого на хроматограмме после дегидрохлорирования экстракта остался, следует считать недостоверным.

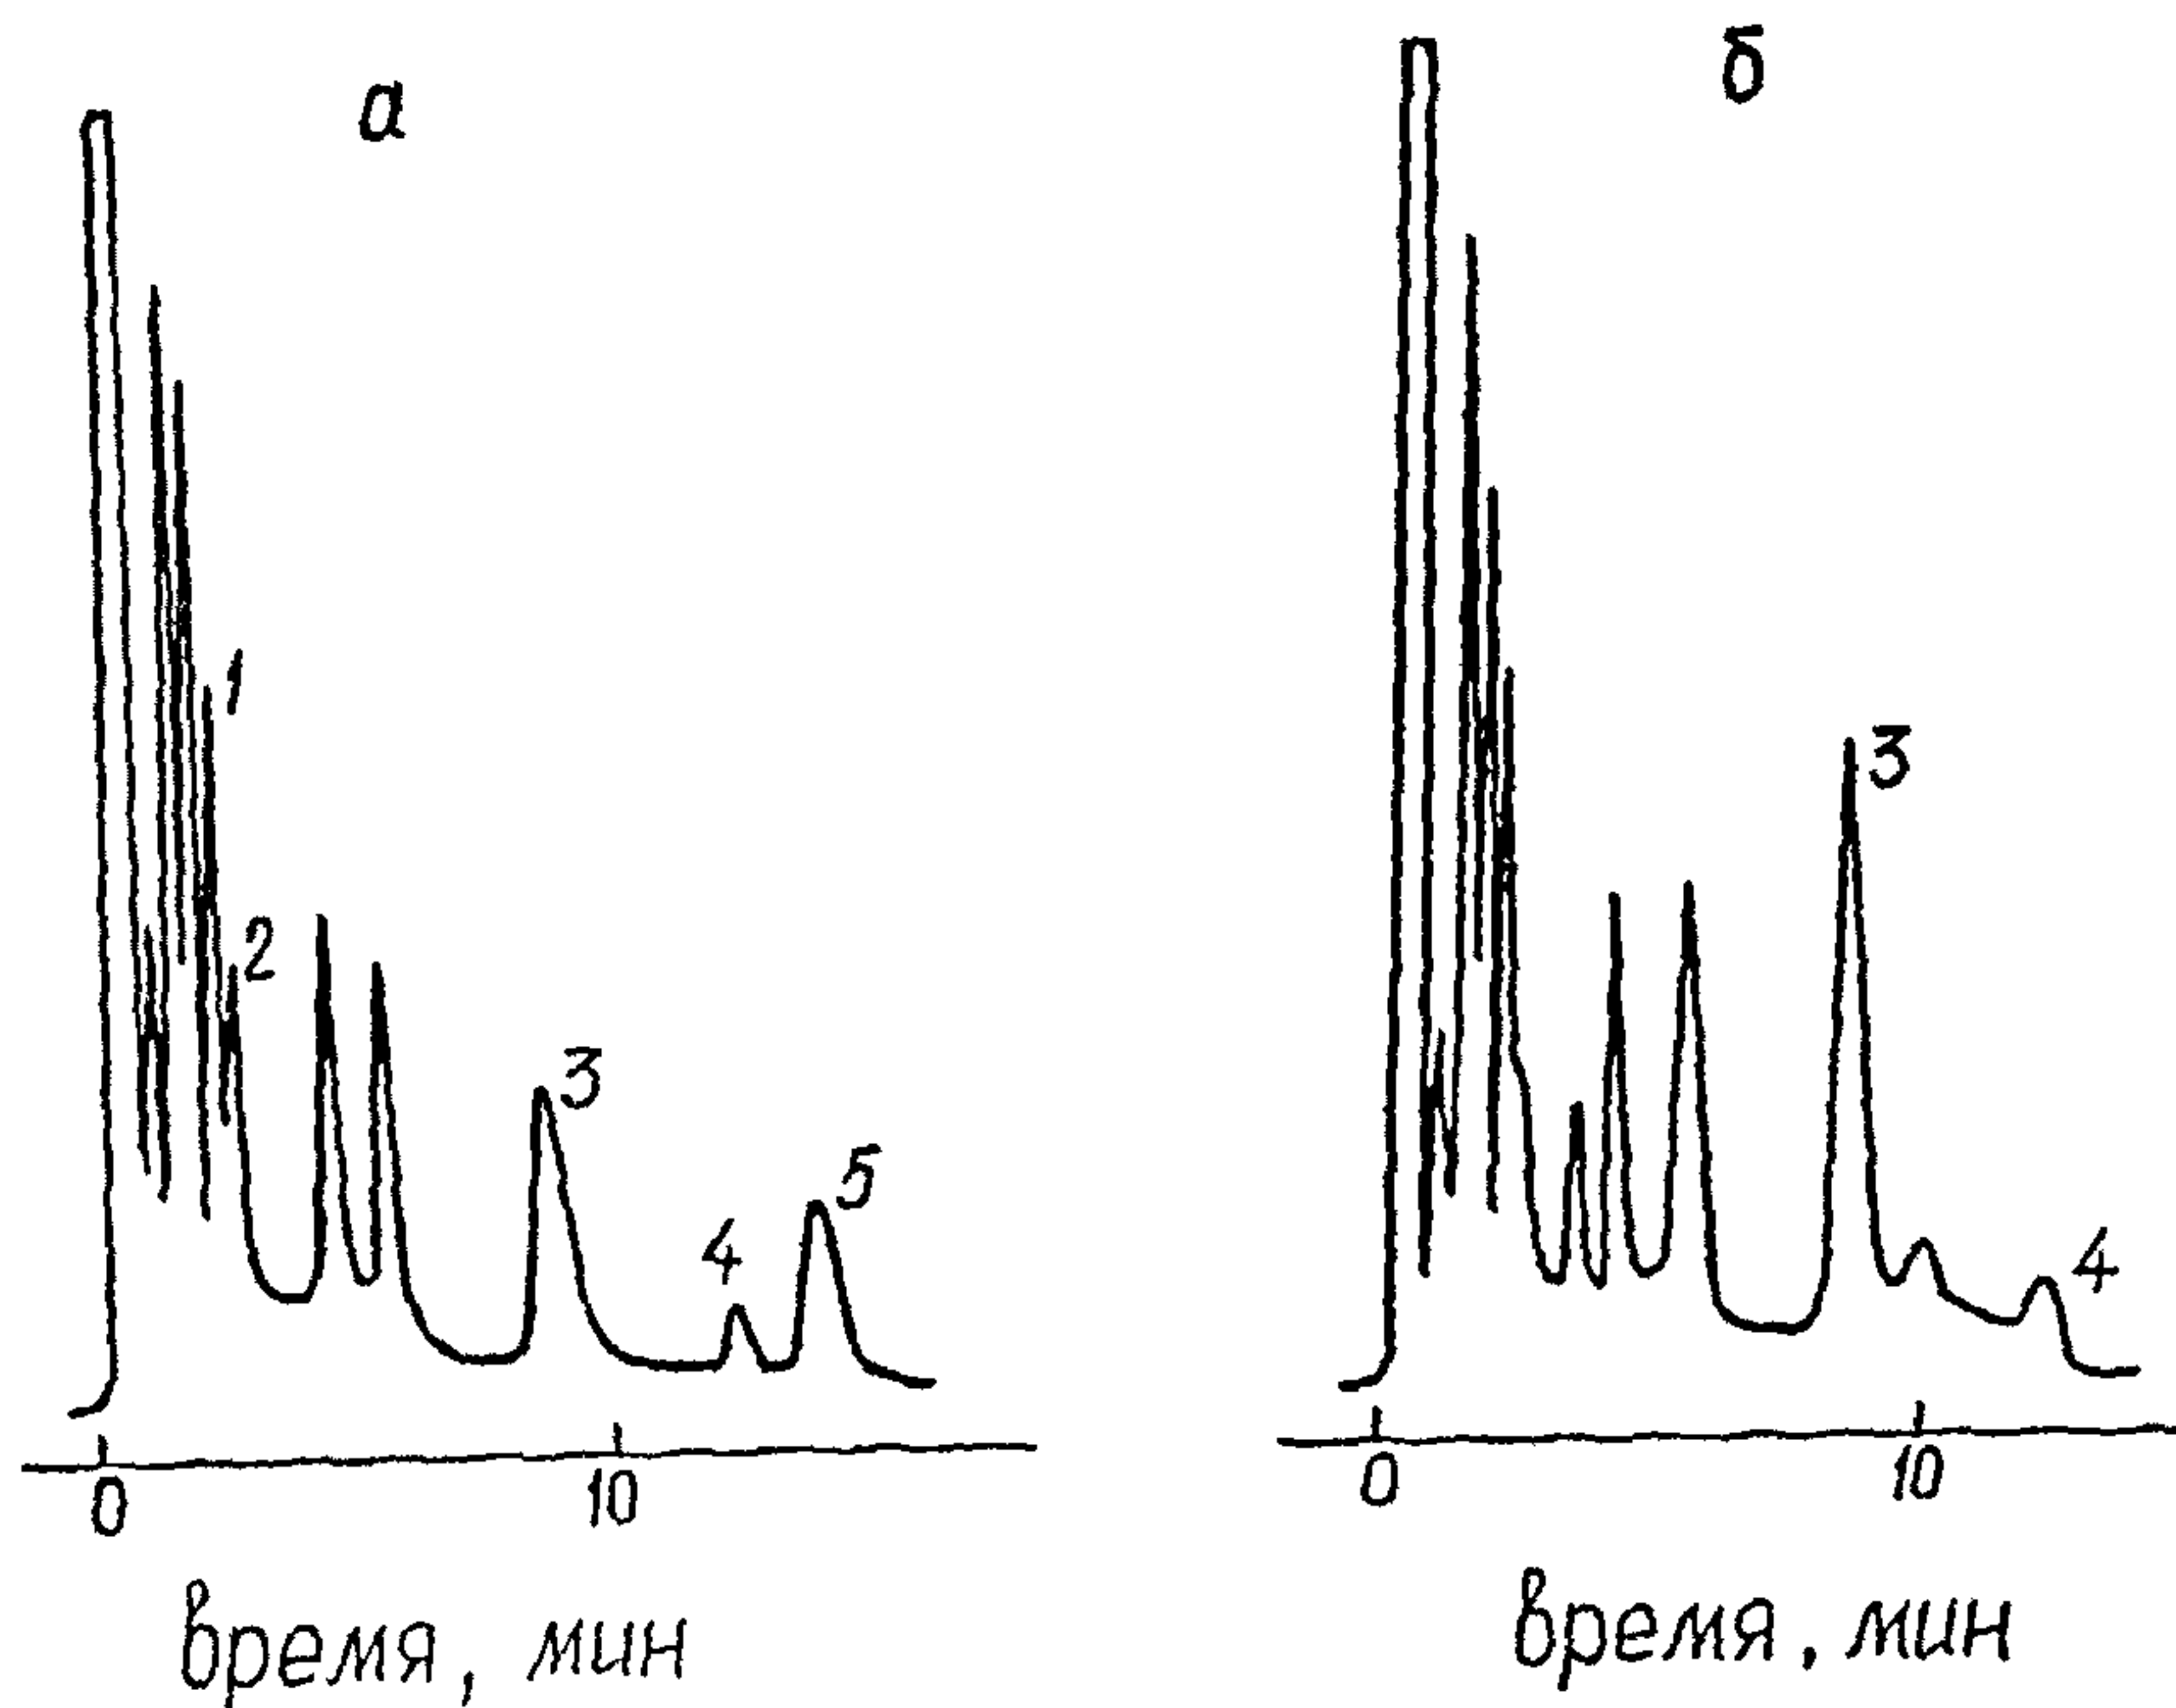

1 - альфа-ГХЦГ, 2 - гамма-ГХЦГ, 3 - 4,4'-ДДЕ, 4 - компонент ПХБ, 5 - 4,4'-ДДТ

Рисунок 7 - Хроматограммы экстракта из природной воды до (а) и после (б) щелочного дегидрохлорирования

8 Вычисление результатов измерений

8.1 Вычисление результатов измерений массовой концентрации галогенорганических пестицидов

Массовую концентрацию ГХБ, альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, дигидрогептахлора, дикофола, трифлуралина определяют по

хроматограмме, полученной на колонке с неподвижной фазой ХЕ-60; 4,4'-ДДД и 4,4'-ДДТ - по хроматограмме, полученной на колонке с фазой SE-30, а массовая концентрация 4,4'-ДДЭ может быть определена по любой хроматограмме.

Если анализ проб воды осуществляли по варианту 1, то массовую концентрацию каждого пестицида рассчитывают по формуле (1)

$$C_x = \frac{C_{cm} \cdot h_x \cdot V_1 \cdot K}{h_{cm} \cdot V_2}, \quad (1)$$

если же анализ осуществляли по варианту 2, то массовую концентрацию каждого пестицида рассчитывают по формуле (2):

$$C_x = \frac{C_{cm} \cdot h_x \cdot (V_1 - a) \cdot K}{h_{cm} \cdot V_2}, \quad (2)$$

где C_x - концентрация пестицида в анализируемой пробе, мкг/дм³;

C_{cm} - концентрация пестицида в стандартном растворе смеси пестицидов, мкг/см³;

h_x - высота пика определяемого пестицида на хроматограмме экстракта из пробы воды, мм;

h_{cm} - высота пика определяемого пестицида на хроматограмме стандартного раствора смеси пестицидов, мм;

V_1 - объём экстракта после концентрирования (7.2.4), если определение проводили по варианту 1, или объём н-гексана, взятый для микроэкстракции, если определение проводили по варианту 2, см³;

V_2 - объём пробы воды, взятый для анализа, дм³;

a - величина, учитывающая потери экстракта, получаемого по 7.3.1, равная 0,4 см³ при окружающей температуре до 25 °С и 0,5 см³ при температуре свыше 25°С;

K - коэффициент, учитывающий потери данного пестицида в процессе анализа.

В случае проведения дополнительной очистки экстрактов от элементарной серы и содержащих серу соединений с помощью ТБА (7.7) содержание ГХБ, альфа-ГХЦГ, бета-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ, трифлуралина, дигидрогептахлора, дикофола находят умножением C на 1,25, а содержание 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ и 4,4'-ДДД - умножением C на 1,11. При очистке экстрактов от содержащих серу соединений с помощью активированной меди (7.7) корректировку величины C не проводят.

Если та или иная часть аттестованного диапазона концентраций какого-либо пестицида (таблицы 2-3) попадает в диапазон нелинейного детектирования, то для этой части диапазона концентраций пестицида строят градуировочный график.

Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

$$C_x \pm \Delta, \text{ мкг/дм}^3 \text{ (} P = 0,95 \text{),} \quad (3)$$

где Δ - характеристика погрешности измерения для данной массовой концентрации конкретного соединения (таблицы 2, 3).

Численные значения результата измерения должны оканчиваться цифрой того же разряда, что и значения характеристики погрешности.

8.2 Вычисление коэффициентов пересчёта

Коэффициент пересчёта (K) того или иного пестицида вычисляют по формуле

$$K = \frac{C_d}{C_{np} - C}, \quad (4)$$

где C_d - добавка данного пестицида к пробе воды, мкг/дм^3 ;

C_{np} - концентрация данного пестицида в пробе воды с добавкой (среднее из 4-5 определений), мкг/дм^3 ;

C - концентрация данного пестицида в пробе воды без добавки (среднее из 4-5 определений), мкг/дм³.

Если анализ проб осуществляли по варианту 1, то величины C_{np} и C в формуле (4) находят по формуле (5)

$$C_{np} \text{ или } C = \frac{C_{cm} \cdot h_v \cdot V_1}{h_{cm} \cdot V_2}, \quad (5)$$

или, если анализ осуществляли по варианту 2, - по формуле (6)

$$C_{np} \text{ или } C = \frac{C_{cm} \cdot h_v \cdot (V_1 - a)}{h_{cm} \cdot V_2}, \quad (6)$$

где значения символов те же, что и в формулах (1) и (2), приведенных в 8.1.

9 Контроль погрешности измерений

Оперативный контроль погрешности проводят с использованием метода добавок. Периодичность контроля - не менее одной контрольной на 15-20 рабочих проб за период, в течение которого условия проведения анализа неизменны.

Для выполнения контроля измеряют концентрацию каждого пестицида в пробе без добавки (C) и в пробе с известной добавкой (C_{np}). Добавка (C_d) к пробе должна составлять не более 100 % от содержания конкретного пестицида в пробе. При отсутствии пестицида в пробе добавка должна быть равна удвоенной минимально определяемой концентрации. Пробу с добавкой анализируют одновременно с рабочими пробами.

Результат контроля признают удовлетворительным, если:

$$| C_{np} - C - C_d | \leq K_p \quad (7)$$

Норматив контроля (K_n) рассчитывают по формуле:

$$K_n = \Delta_c + 2,77 \sigma(\dot{\Delta}) \quad (P=0,95), \quad (8)$$

где Δ_c и $\sigma(\dot{\Delta})$ - характеристики систематической и случайной составляющих погрешности измерения концентрации конкретного пестицида в пробе без добавки С (таблицы 2, 3).

Если в исходной пробе определяемый пестицид не обнаружен, то погрешность рассчитывают для концентрации добавки.

При превышении норматива повторяют измерения с использованием другой пробы. При повторном превышении норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

10 Требования безопасности

10.1 При выполнении измерений массовой концентрации галогенорганических пестицидов в пробах природных и очищенных сточных вод соблюдают требования безопасности, установленные в "Правилах по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета", Л., Гидрометеиздат, 1983, или в "Типовой инструкции по технике безопасности для гидрохимических лабораторий служб Роскомвода", М., 1995.

10.2 По степени воздействия на организм вредные вещества, используемые при выполнении определений, относятся к 1, 2, 3, 4 классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

10.3 Содержание используемых вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

10.4 Определение следует проводить при наличии вытяжной вентиляции. Оператор, выполняющий определение, должен быть проинструктирован о специфических мерах предосторожности при

работе с галогенорганическими пестицидами.

10.5 Оператор, выполняющий измерения на хроматографе должен знать правила безопасности при работе с электрооборудованием, сжатыми и горючими газами.

11 Требования к квалификации операторов

Анализ проб на содержание галогенорганических пестицидов должен выполняться квалифицированным химиком-аналитиком, прошедшим соответствующую подготовку, знающим основы газовой хроматографии, владеющим техникой экстрагирования, очистки растворителей и хроматографирования.

12 Затраты времени на проведение анализа

Для проведения анализа серии из 6 проб воды по варианту 1 требуется:

- на подготовку посуды - 1,5 чел.-ч;
- на приготовление реактивов, материалов и растворов - 1,5 чел.-ч;
- на проведение определения и вычисления - 18 чел.-ч.

Для проведения анализа серии из 6 проб воды по варианту 2 требуется:

- на подготовку посуды - 1,5 чел.-ч;
- на приготовление реактивов, материалов и растворов - 1,5 чел.-ч;
- на проведение определения и вычисления - 14 чел.-ч.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО N 66
об аттестации МВИ**

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ массовой концентрации гексахлорбензола, альфа-, бета- и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах газохроматографическим методом.

ОСНОВАНА на извлечении пестицидов из воды экстрагированием н-гексаном, очистке экстракта концентрированной серной кислотой и количественном их определении методом газожидкостной хроматографии с детектором по захвату электронов.

РАЗРАБОТАНА Гидрохимическим институтом.

РЕГЛАМЕНТИРОВАНА в РД 52.24.412-95.

АТТЕСТОВАНА в соответствии с ГОСТ Р 8.563 (ГОСТ 8.010).

АТТЕСТАЦИЯ проведена Гидрохимическим институтом на основании результатов экспериментальных исследований в 1992 г. и метрологической экспертизы материалов в 1995 г.

В результате аттестации МВИ установлено:

1. МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

Значения характеристик погрешности и ее составляющих представлены в таблицах 1 и 2

Таблица 1 - Значения характеристик погрешности и её составляющих при определении галогенорганических пестицидов по варианту 1 методики (P=0,95)

Пестицид	Диапазон измеряемых концентраций С, мкг/дм ³	Характеристики составляющих погрешности, мкг/дм ³		Характеристика погрешности, мкг/дм ³ , Δ
		случайной, $\sigma\left(\Delta\right)$	систематической Δ _с	
ГХБ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,056 \text{ С}$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,045 \text{ С}$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,11 \text{ С}$
Альфа-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,087 \text{ С}$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,069 \text{ С}$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,17 \text{ С}$
Бета-ГХЦГ	0,010 - 0,300	$0,001 + 0,056 \text{ С}$	$0,001 + 0,045 \text{ С}$	$0,003 + 0,11 \text{ С}$
Гамма-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,090 \text{ С}$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,072 \text{ С}$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,18 \text{ С}$
Дигидро-гептахлор	0,0050 – 0,150	$3 \cdot 10^{-4} + 0,061 \text{ С}$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,049 \text{ С}$	$7 \cdot 10^{-4} + 0,12 \text{ С}$
4,4'-ДДЕ	0,0050 – 0,150	$0,001 + 0,047 \text{ С}$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,037 \text{ С}$	$0,002 + 0,093 \text{ С}$
4,4'-ДДД	0,010 – 0,300	$6 \cdot 10^{-4} + 0,11 \text{ С}$	$5 \cdot 10^{-4} + 0,085 \text{ С}$	$0,001 + 0,22 \text{ С}$
4,4'-ДДТ	0,020 – 0,500	$0,005 + 0,048 \text{ С}$	$0,004 + 0,038 \text{ С}$	$0,010 + 0,096 \text{ С}$
Дикофол	0,020 – 0,500	$0,003 + 0,045 \text{ С}$	$0,002 + 0,036 \text{ С}$	$0,005 + 0,090 \text{ С}$
Трифлу-ралин	0,0050 – 0,150	$8 \cdot 10^{-4} + 0,074 \text{ С}$	$6 \cdot 10^{-4} + 0,059 \text{ С}$	$0,0016 + 0,15 \text{ С}$

Таблица 2 - Значения характеристик погрешности и её составляющих при определении галогенорганических пестицидов по варианту 2 методики (P=0,95)

Пестицид	Диапазон измеряемых концентраций С, мкг/дм ³	Характеристики составляющих погрешности, мкг/дм ³		Характеристика погрешности, мкг/дм ³ , Δ
		случайной, $\sigma\left(\Delta\right)$	систематической, Δ _с	
ГХБ	0,0020 - 0,0500	$4 \cdot 10^{-4} + 0,044 \text{ С}$	$3 \cdot 10^{-4} + 0,035 \text{ С}$	$8 \cdot 10^{-4} + 0,089 \text{ С}$
Альфа-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$6 \cdot 10^{-4} + 0,10 \text{ С}$	$4 \cdot 10^{-4} + 0,081 \text{ С}$	$0,0011 + 0,20 \text{ С}$

Пестицид	Диапазон измеряемых концентраций С, мкг/дм ³	Характеристики составляющих погрешности, мкг/дм ³		Характерис- тика погрешности, мкг/дм ³ , Δ
		случайной, $\sigma(\dot{\Delta})$	систематичес- кой, Δ_c	
Бета-ГХЦГ	0,010 - 0,300	0,002+0,049 С	0,001+0,040 С	0,003+0,089 С
Гамма-ГХЦГ	0,0020 - 0,0500	$5 \cdot 10^{-4}$ +0,079 С	$4 \cdot 10^{-4}$ +0,063 С	0,0010+0,16 С
Дигидро-гептахлор	0,0050 – 0,150	0,0012+0,020 С	$0,0010^4$ +0,016 С	0,0024+0,041 С
4,4'-ДДЕ	0,0050 – 0,150	0,001+0,036 С	$8 \cdot 10^{-4}$ +0,029 С	0,0019+0,072 С
4,4'-ДДД	0,010 – 0,300	0,003+0,019 С	0,002+0,015 С	0,005+0,039 С
4,4'-ДДТ	0,020 – 0,200 св. 0,200-0,500	0,001+0,092 С 0,019	0,001+0,073 С 0,015	0,003+0,18 С 0,038
Дикофол	0,020 – 0,500	0,001+0,060 С	0,001+0,048 С	0,003+0,12 С
Трифлуралин	0,0050 – 0,0500 св.0,0500 - 0,150	0,15 С 0,0074	0,12 С 0,0059	$1 \cdot 10^{-4}$ +0,29 С 0,015

2. Оперативный контроль погрешности измерений проводят в соответствии с разделом 9 РД 52.24.412-95.

3. Дата выдачи свидетельства март 1995 г.

Главный метролог ГУ ГХИ



А.А. Назарова