

ГОСТ Р 50442—92

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ
РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕРЫ**

Издание официальное

36 руб. **Б3 11-92/1078**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ****Рентгено-флуоресцентный метод определения серы**

Petroleum and petroleum products X-ray
fluorescence method for determination of
sulphur content

ГОСТ Р
50442—92

ОКСИУ 3209

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли серы в нефтях и нефтепродуктах в диапазоне 0,05—5,0%.

Сущность метода заключается в измерении интенсивности флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при облучении исследуемой пробы рентгеновскими лучами.

Стандарт не распространяется на нефть и нефтепродукты, содержащие кремний, фосфор, кальций, калий и галоиды более 0,1%, а также на этилированные бензины.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ

Анализатор рентгено-флуоресцентный типа АС-1.

Кюветы измерительные, изготовленные из оргстекла, фторопластика, полистирола, алюминия (черт. 1).

Колбы конические или стаканы по ГОСТ 25336.

Весы лабораторные общего назначения с пределами взвешивания 200 г, не ниже второго класса точности.

Пипетки вместимостью 5 см³ по ГОСТ 20292.

Образцы стандартные типа S_{рф} двух видов (калибровочные и поверочные растворы).

Присадка КИНХ-2 по ТУ 38 101980—84 или любая другая высокосернистая присадка, не содержащая элементов, указанных во вводной части.

Издание официальное



(C) Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

С. 2 ГОСТ Р 50442—92

Масло вазелиновое медицинское по ГОСТ 3164.

Бензин-растворитель для резиновой промышленности по ТУ 38.401—67—108—92 или другой растворитель, близкий по пределам выкипания.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Ткань безворсовая.

Мешалка магнитная любого типа.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300 или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Подготовка анализатора

2.1.1. Подготавливают анализатор в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации. Включают анализатор в сеть и прогревают не менее 30 мин.

2.1.2. Кювету промывают бензином-растворителем, затем спиртом и высушивают воздухом или вытирают безворсовой тканью.

2.1.3. Исходя из предварительного содержания серы в испытуемом образце, проводят калибровку анализатора с использованием двух стандартных образцов типа $S_{\text{рф}}$ — калибровочных растворов. В первом калибровочном растворе массовая доля серы должна быть меньше предполагаемой в испытуемом образце, во втором — больше. Выбирают калибровочные растворы с содержанием серы, наиболее близким к испытуемому образцу.

Примечание. Если массовая доля серы неизвестна, проводят предварительные испытания пробы, выбирая для калибровки растворы с содержанием серы 0 и 5. По полученным результатам уточняют выбор растворов для калибровки.

2.1.4. В подготовленную по п. 2.1.2 кювету пипеткой наливают 4 см³ выбранного калибровочного раствора с меньшим содержанием серы. Кювету устанавливают в ячейку анализатора. Производят калибровку в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора.

В другой кювете испытывают калибровочный раствор с большим содержанием серы, проводя такие же операции как с первой кюветой.

2.1.5. При отсутствии стандартных образцов типа $S_{\text{рф}}$ допускается использовать калибровочные растворы, приготовление которых приведено в приложении.

2.2. Подготовка пробы

2.2.1. Отбор проб — по ГОСТ 2517.

2.2.2. Отобранныю пробу продукта тщательно перемешивают в склянке, заполненной не более чем на две трети ее объема, в течение 5 мин.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. В кювету, подготовленную по п. 2.1.2, пипеткой наливают 4 см³ испытуемой пробы. Вязкие продукты предварительно нагревают до температуры, обеспечивающей текучесть.

Кювету устанавливают в ячейку анализатора.

3.2. Массовую долю серы в пробе продукта измеряют в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора (считывают непосредственно с цифрового табло).

3.3. За результат определения принимают среднее арифметическое четырех последовательных измерений, рассчитанное до второго десятичного знака.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух последовательных определений, рассчитанное до второго десятичного знака при массовой доле серы менее 1,0 %, и до первого десятичного знака при массовой доле более 1,0 %.

4. ТОЧНОСТЬ МЕТОДА


4.1. Сходимость

Два результата определений, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, приведенного на черт. 2 для большего результата.


4.2. Воспроизводимость

Два результата испытаний, полученные двумя исполнителями, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, приведенного на черт. 3 для большего результата.


Измерительная кювета

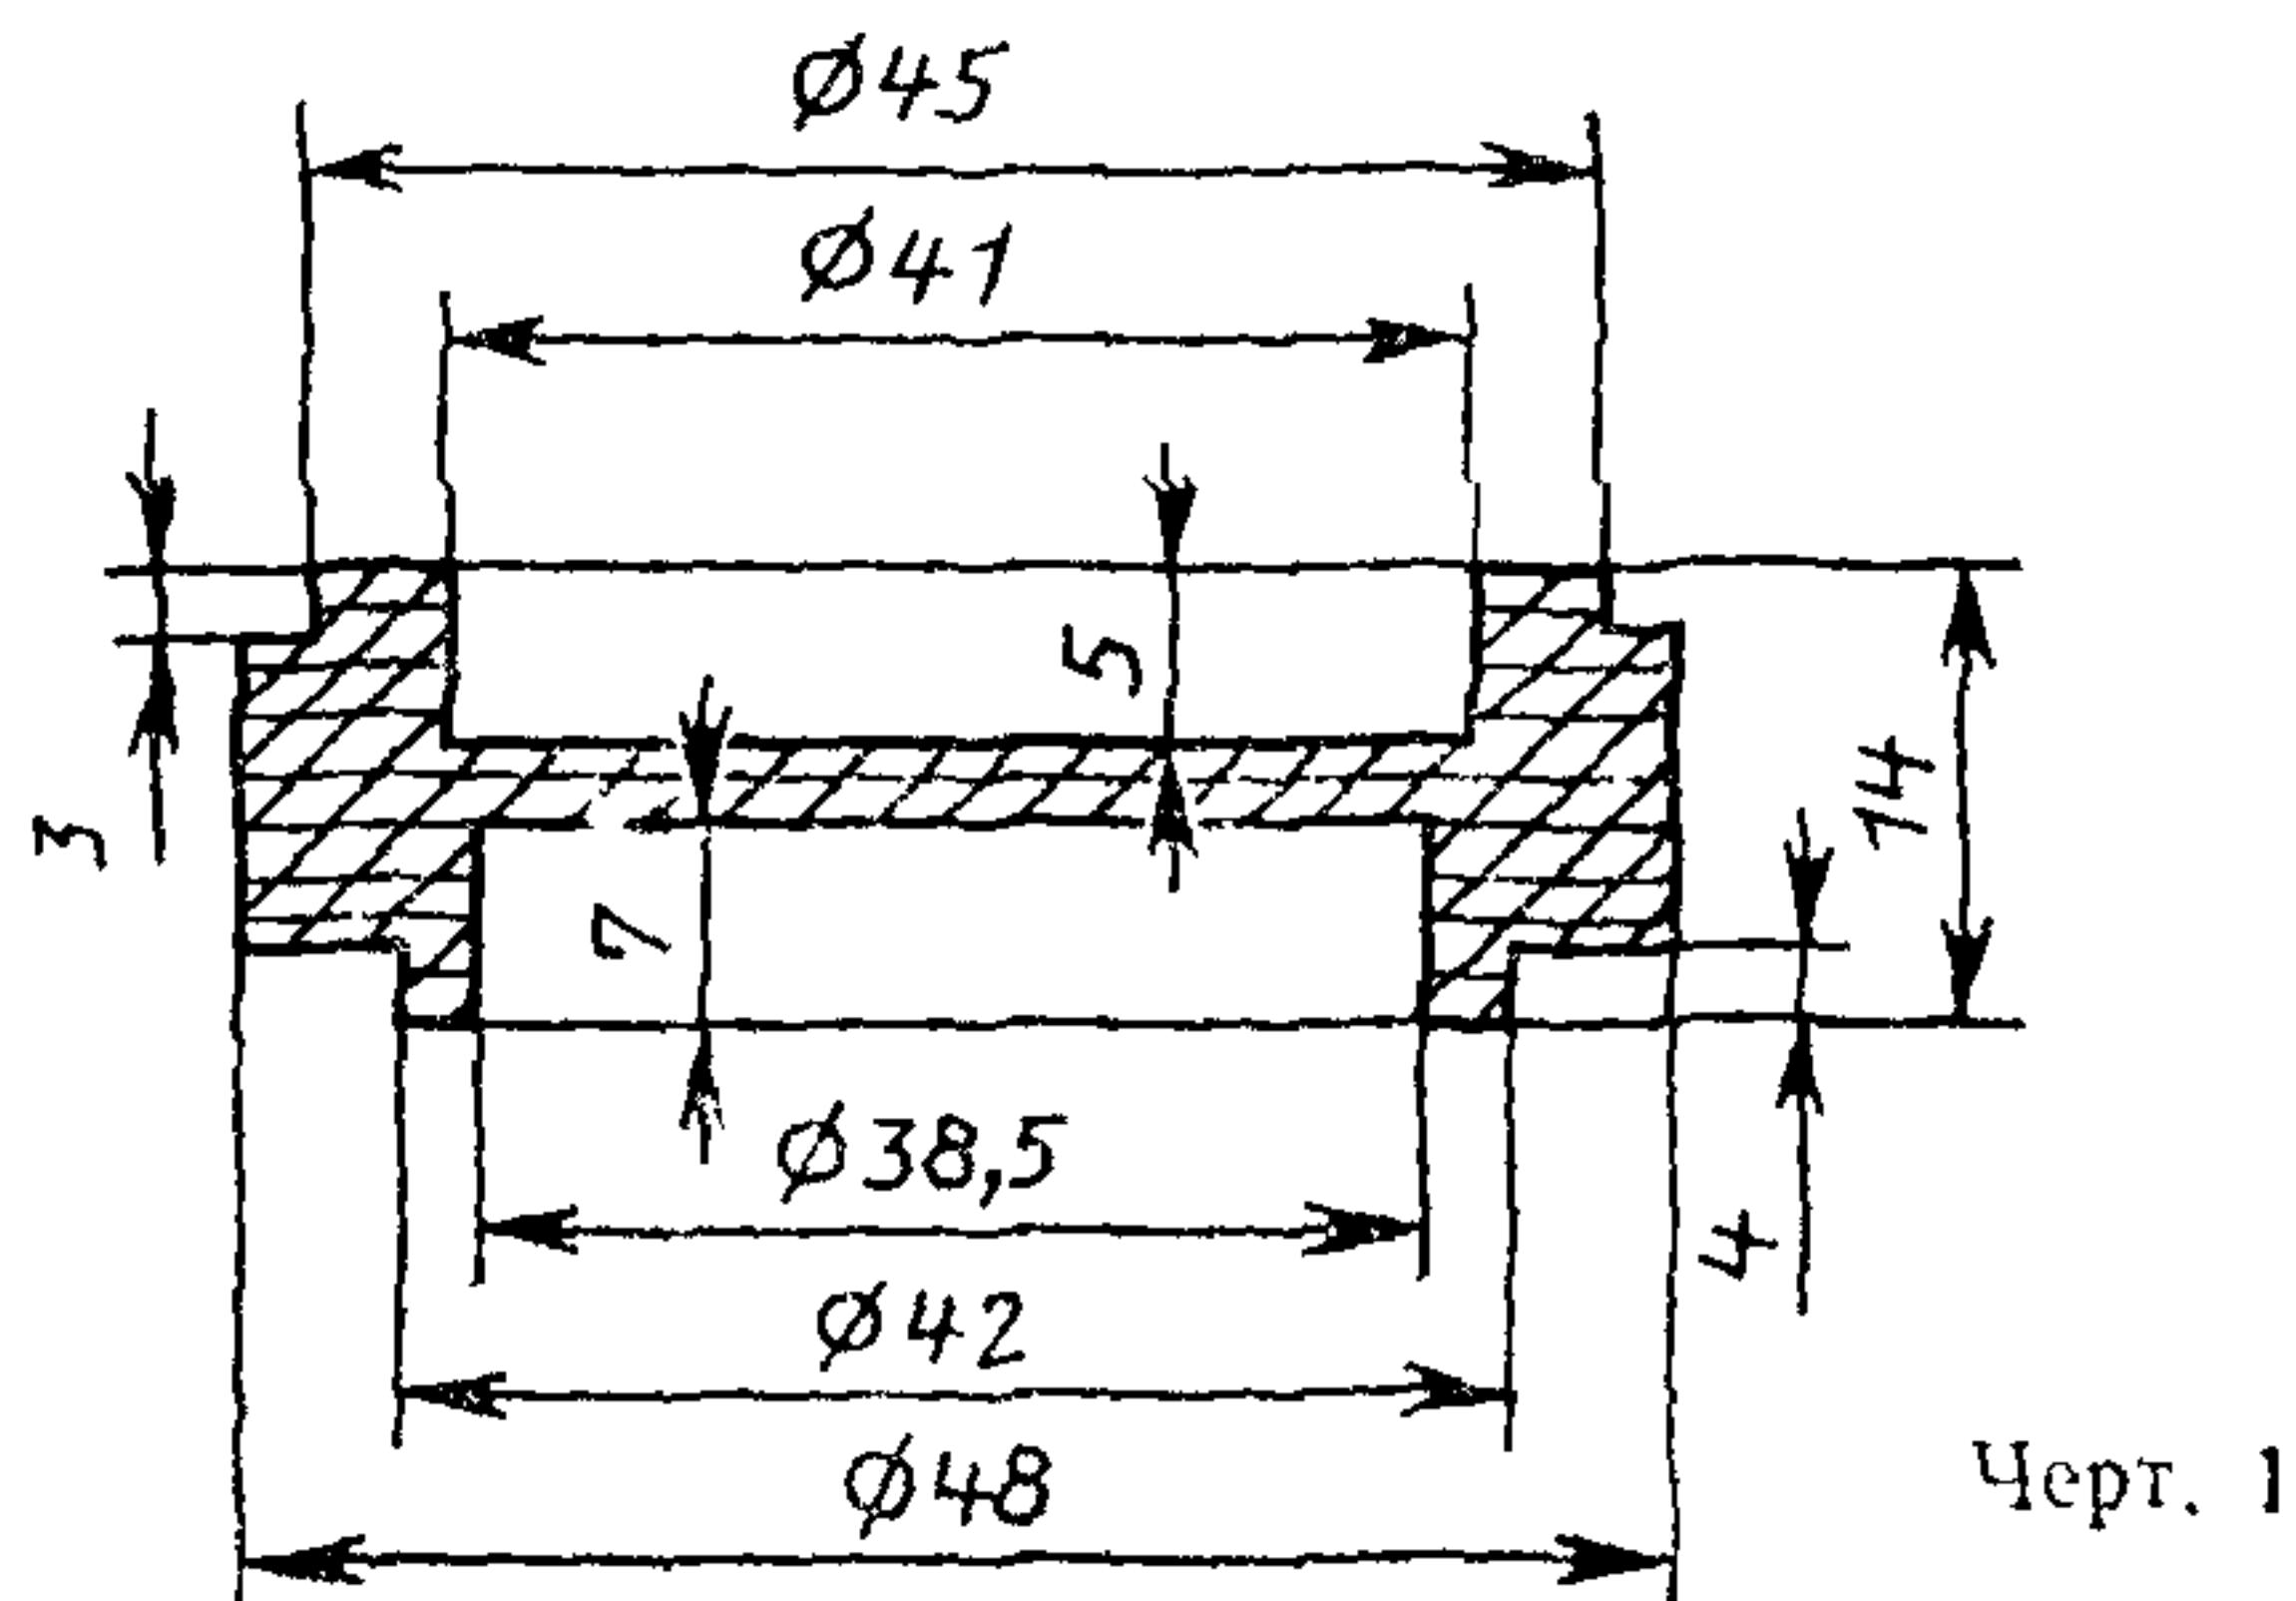

С. 4 ГОСТ Р 50442—92

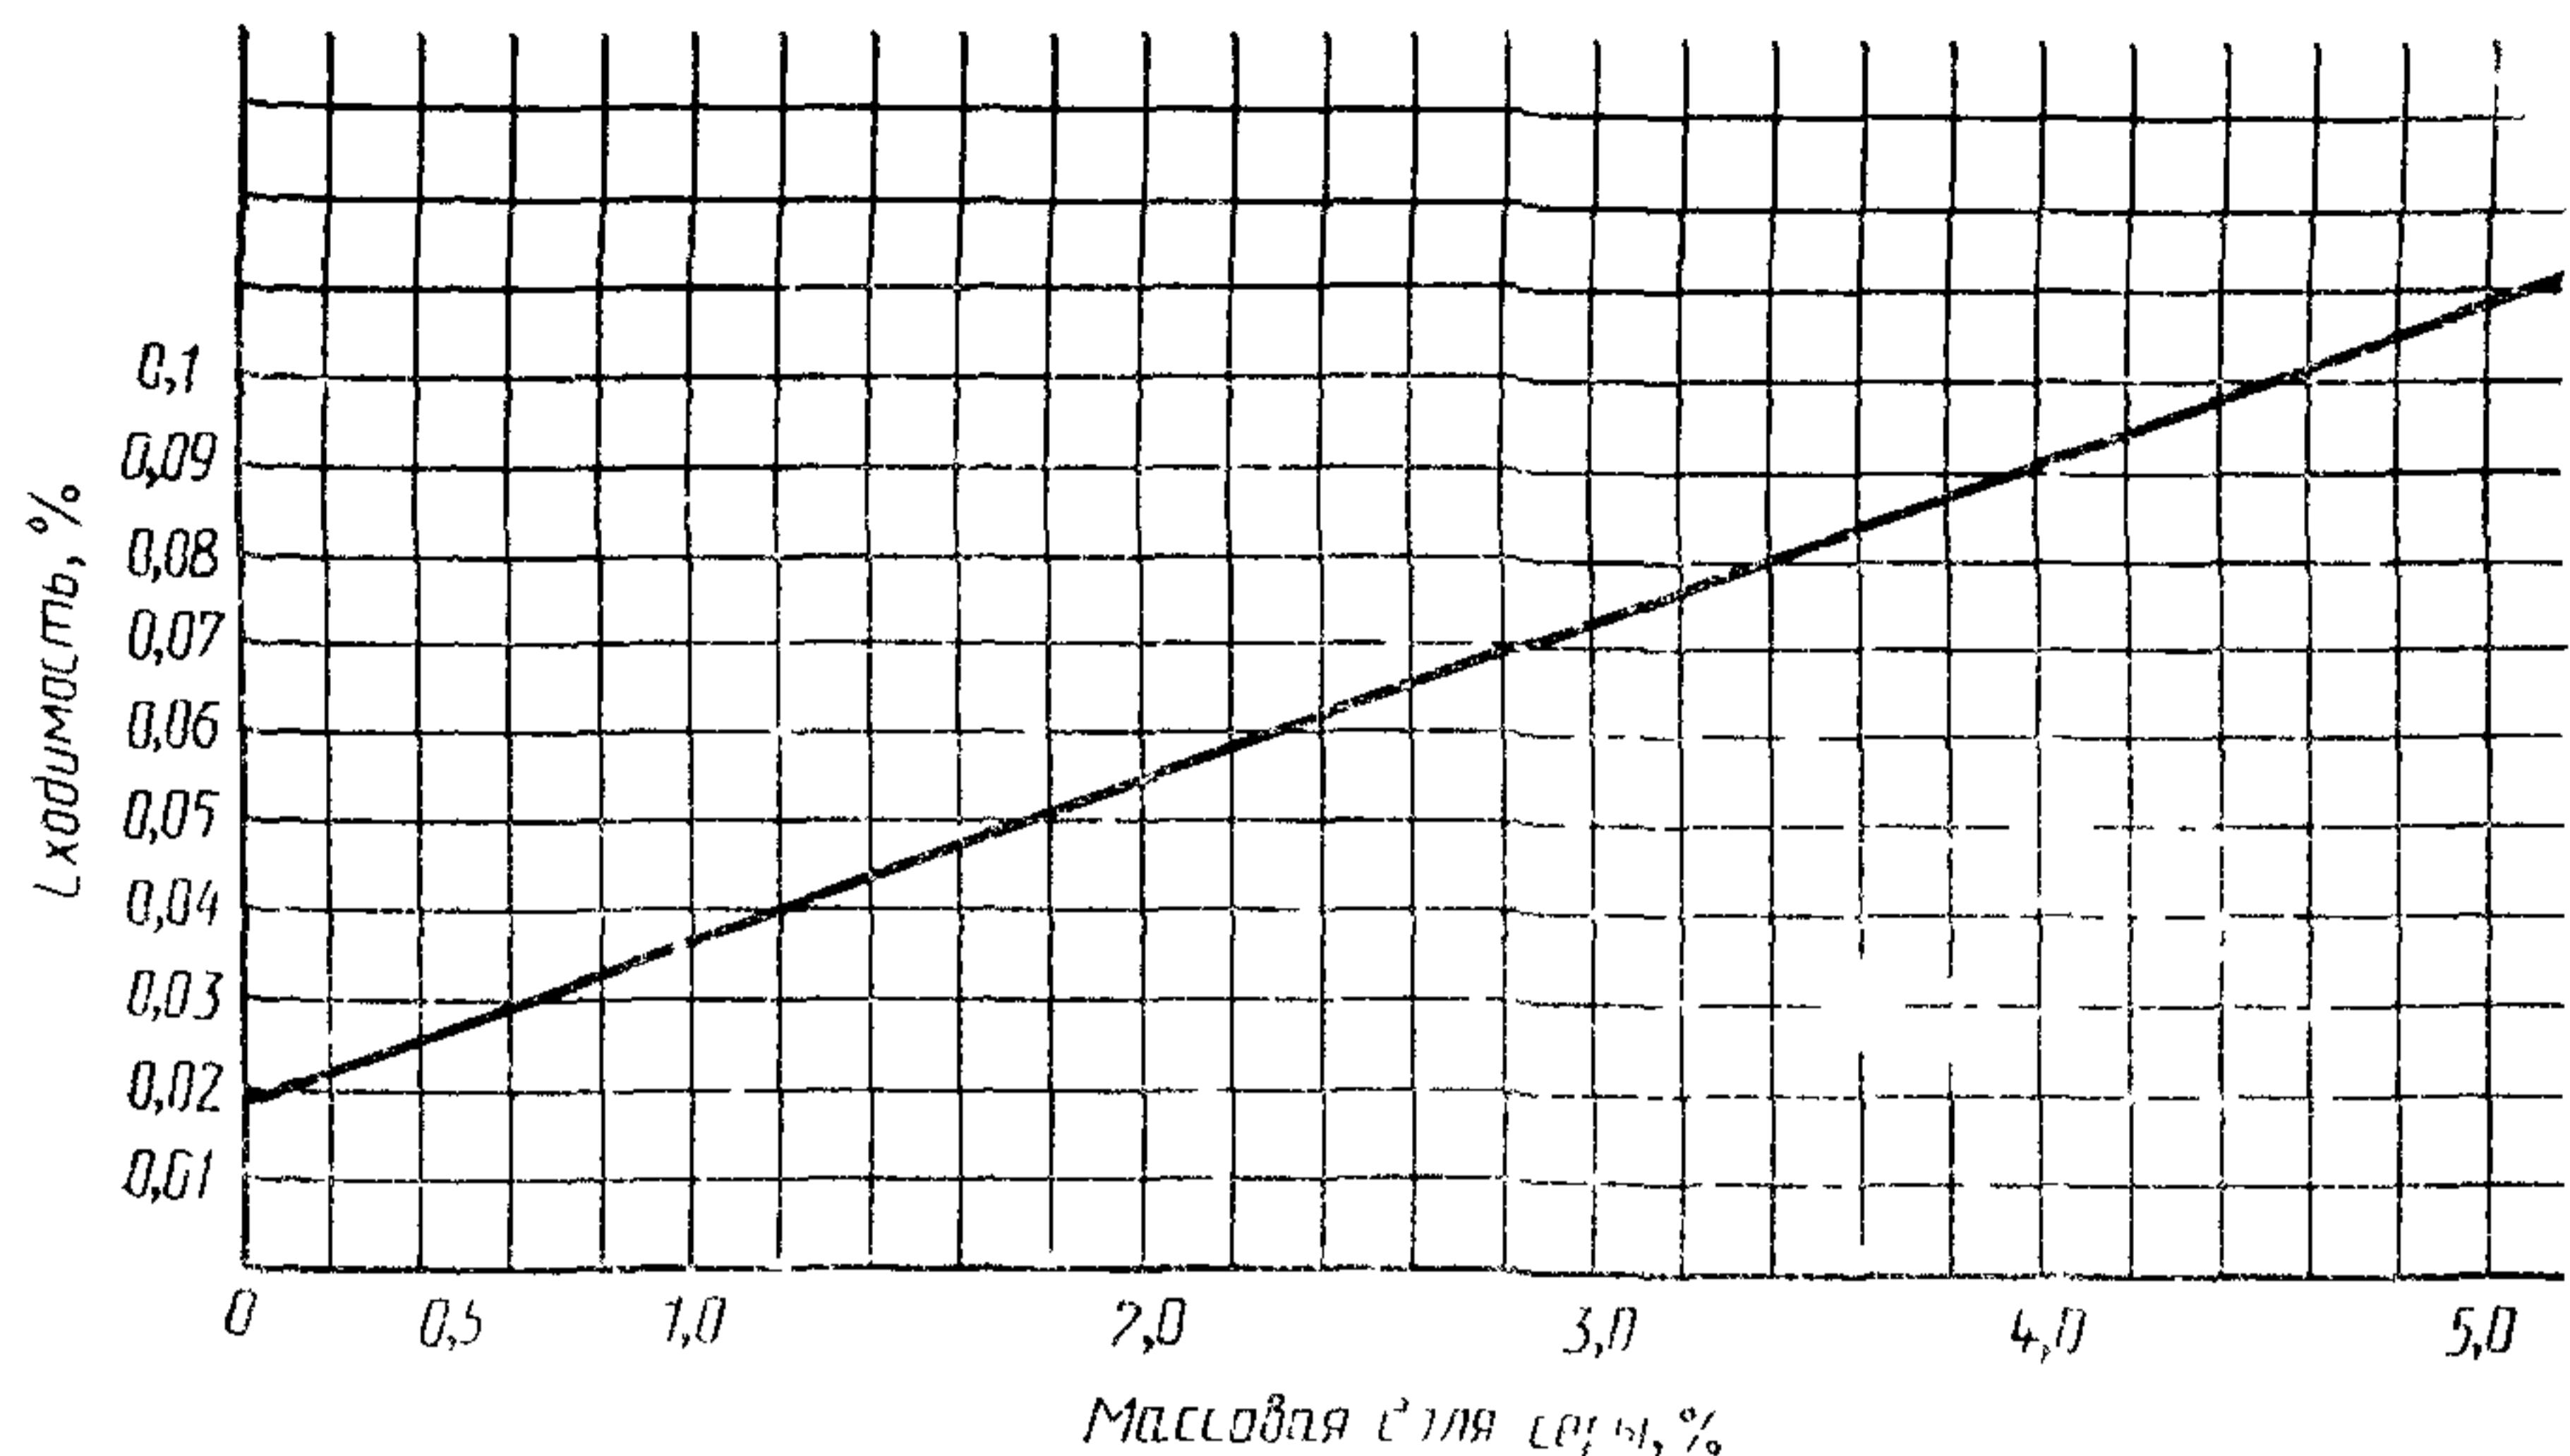

Черт. 2

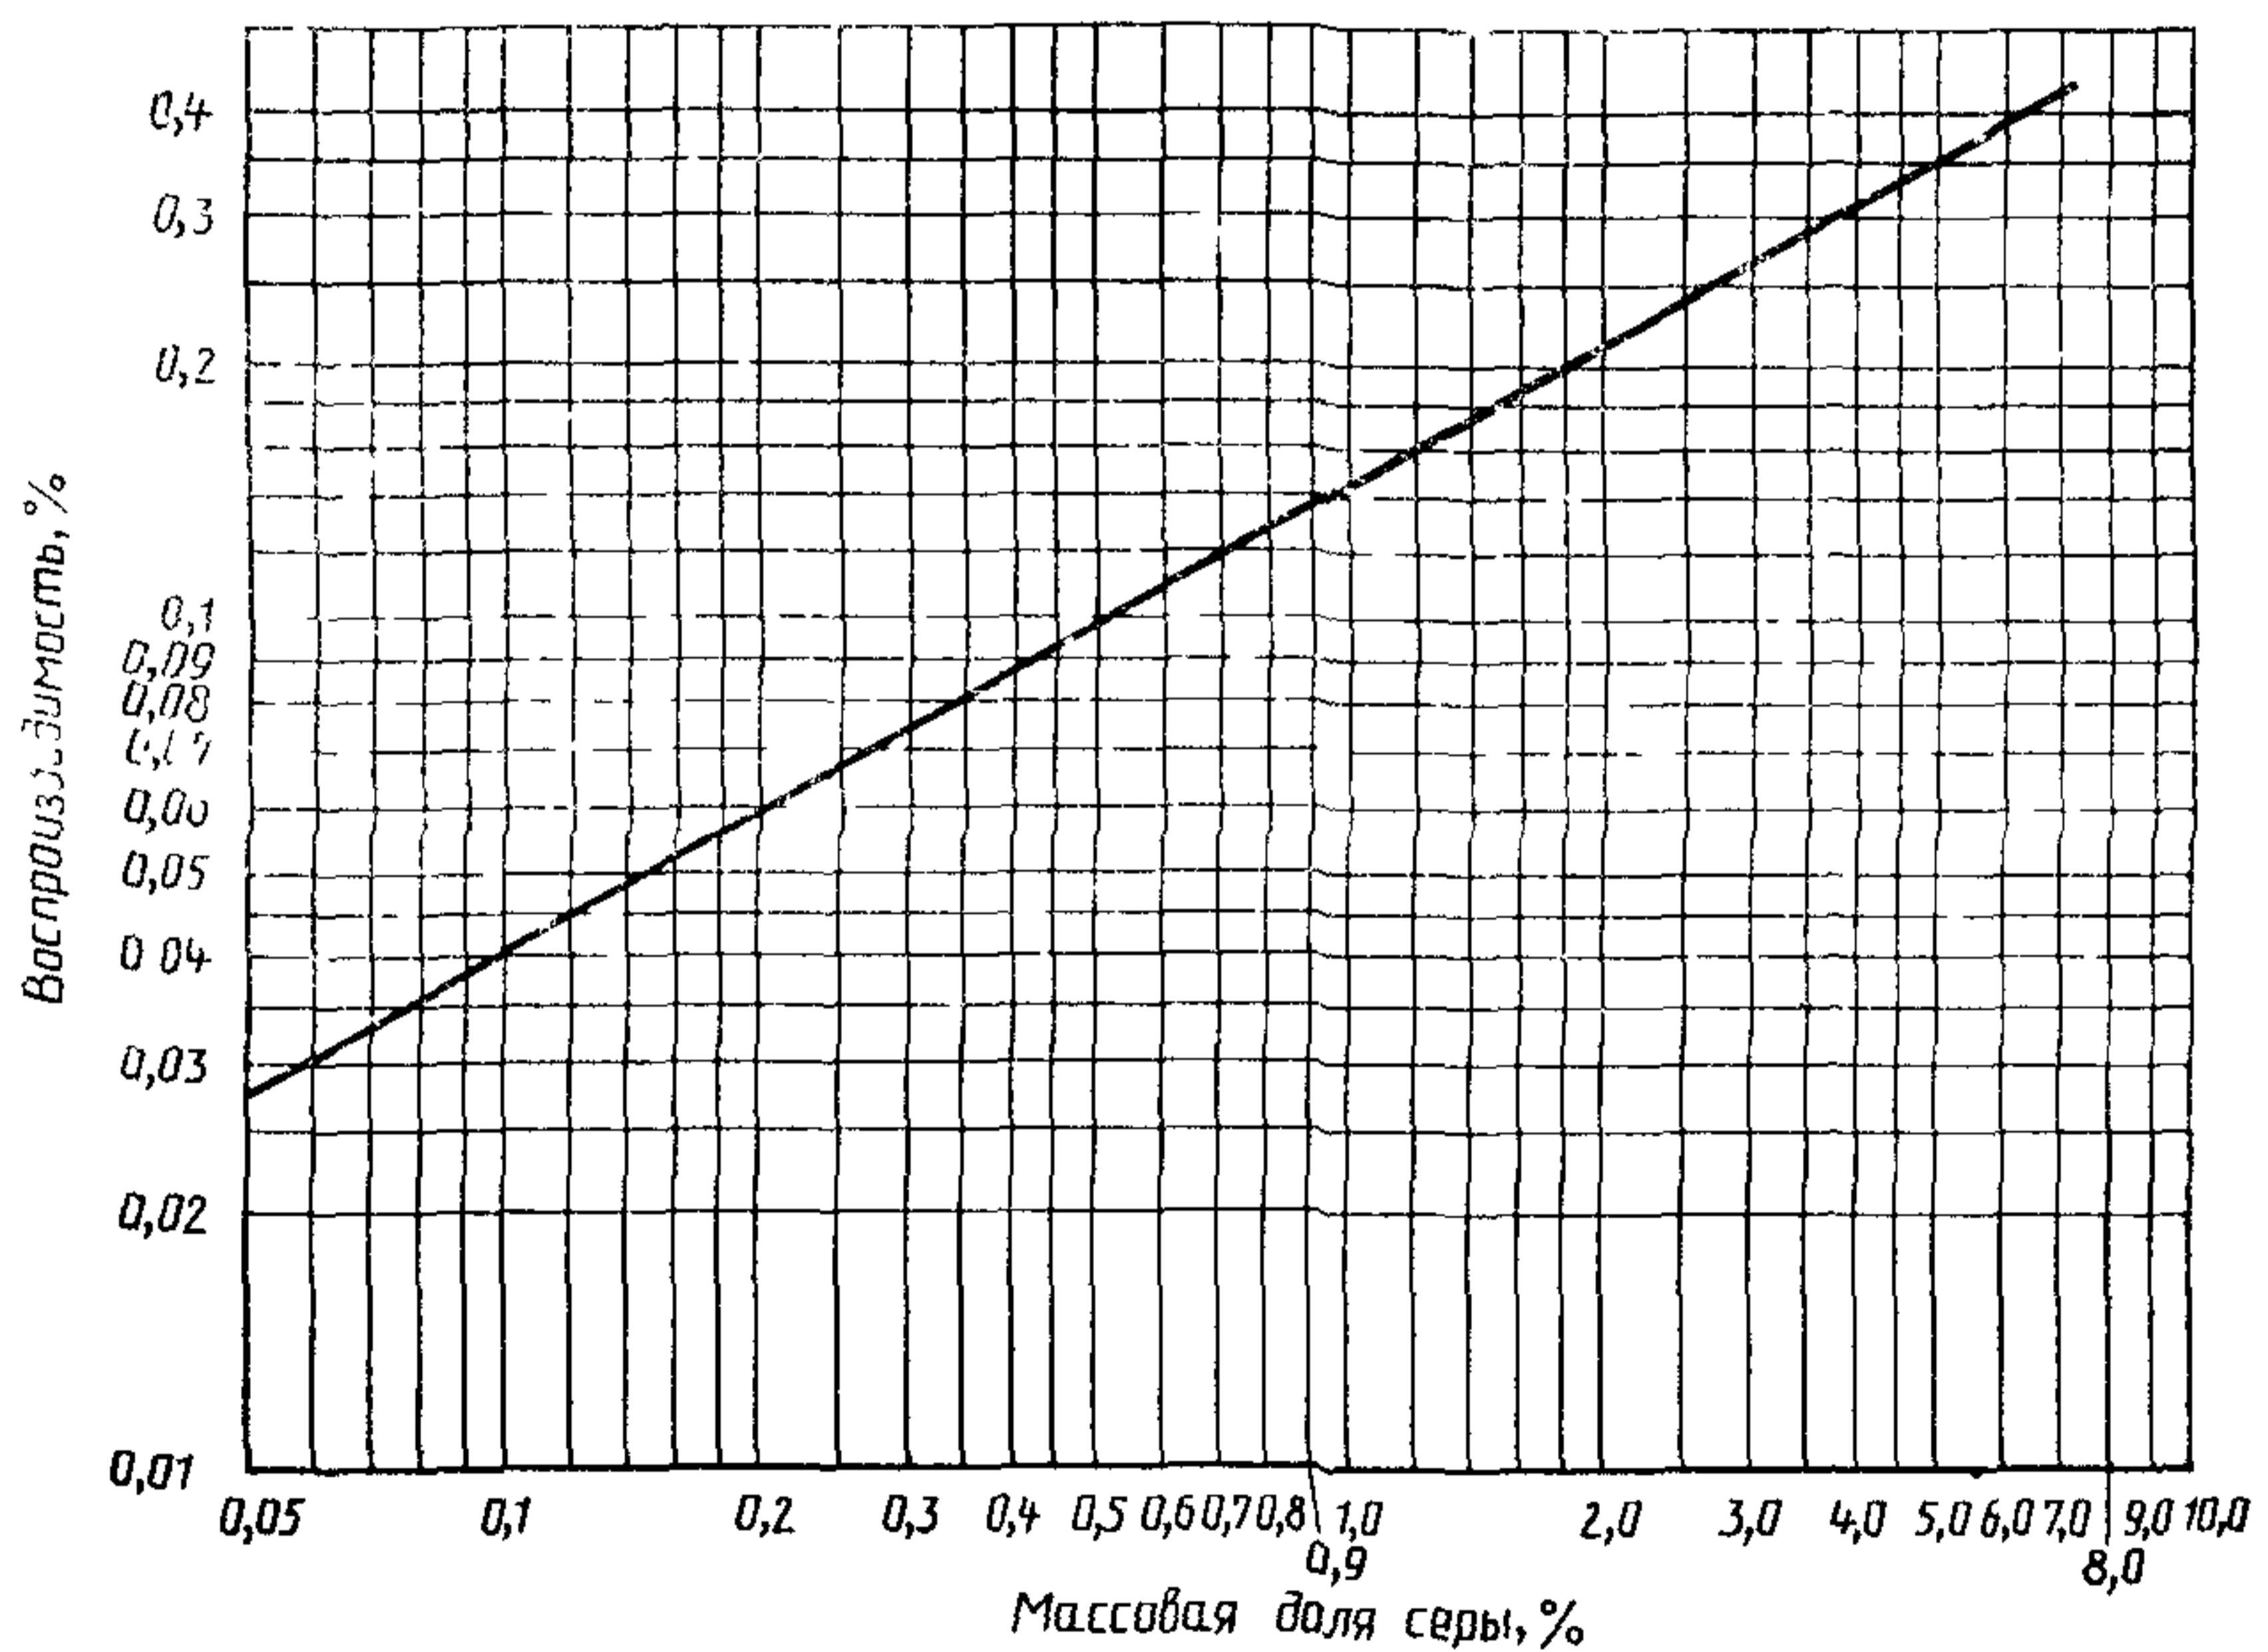

Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАСТВОРОВ

1. Готовят шесть калибровочных растворов с различной массовой долей серы (таблица). Калибровочным раствором № 1 служит вазелиновое масло.

Номер калибровочного раствора (<i>n</i>)	Массовая доля серы, %
1	0,0
2	0,6
3	1,0
4	2,0
5	3,0
6	5,0

Для приготовления остальных пяти калибровочных растворов (растворы № 2—6) используют высокосернистую присадку, указанную в разд. 1 настоящего стандарта, в которой определяют массовую долю серы по ГОСТ 1437 или ГОСТ 3877. Массу присадки для приготовления каждого из пяти калибровочных растворов вычисляют по формуле

$$m_{\text{пр}} = \frac{C_n \cdot m_n}{C_{\text{пр}}}, \quad (1)$$

где C_n — массовая доля серы в калибровочном растворе, %, где $n=2, 3, 4, 5, 6$;

$C_{\text{пр}}$ — массовая доля серы в присадке, %;

m_n — масса калибровочного раствора, г (например 100 г).

2. Рассчитывают массу вазелинового масла (m_m), необходимую для приготовления каждого из пяти калибровочных растворов:

$$m_m = m_n - m_{\text{пр}}. \quad (2)$$

3. В пять предварительно взвешенных стаканов или колб берут соответственно номеру калибровочного раствора (п. 1) присадку с точностью до 0,001 г.

Допускается брать присадку в лодочку или маленький стаканчик с последующим переносом в большую емкость с помощью вазелинового масла.

4. В каждый из пяти стаканов (колб) тщательно с присадкой добавляют вазелиновое масло (п. 2), взвешенное с точностью до 0,01 г, в соответствии с расчетной массой для каждого номера калибровочного раствора.

5. Содержимое стаканов (или колб) тщательно перемешивают в течение 5—10 мин с помощью магнитной мешалки до получения однородного раствора. Затем переливают в склянки с плотно закрывающимися крышками.

6. В каждом из приготовленных калибровочных растворов определяют массовую долю серы по ГОСТ 1437 или ГОСТ 3877. Отклонение от расчетного значения массовой доли серы, указанной в таблице, должно быть в пределах сходимости соответствующего метода определения серы.

7. Калибровочные растворы хранят в темном прохладном месте и используют в течение 6 мес, ежемесячно контролируя массовую долю серы в одном-двух растворах. При появлении осадка или при изменении содержания серы растворы бракуют. Допускается расхождение между результатами определения серы в свежеприготовленном и хранящемся растворах в пределах сходимости используемого стандартизированного метода.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по переработке нефти «ВНИИНП»

РАЗРАБОТЧИКИ

Э. Ф. Каминский; В. В. Булатников; В. Д. Милованов; Т. Г. Скрябина; Л. Г. Нехамкина; Л. А. Садовникова; В. И. Борисова; Т. И. Довгополая; Т. В. Еремина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18.12.92 № 1550

3. Срок первой проверки — 1997 г.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта, приложения
ГОСТ 1437—75	Приложение
ГОСТ 2517—85	2 2 1
ГОСТ 3164—78	1
ГОСТ 3877—88	Приложение
ГОСТ 12026—76	1
ГОСТ 17299—78	1
ГОСТ 18300—87	1
ГОСТ 20292—74	1
ГОСТ 25336—82	1
ТУ 38.101980—84	1

Редактор Р. С. Федорова

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор В. М. Смирнова

Сдано в набор 14.01.93. Подп. в печ. 10.03.93 Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр-отт. 0,5.
Уч.-изд. л. 0,45. Тир. 440 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., б. Зак. 28